

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



安康市人民医院宫腹腔镜手术系统 采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312

公 开 招 标 文 件

采购单位：安康市人民医院

代理机构：陕西德信招标有限公司

2025 年 3 月



目 录

第一部分 招标公告 1

第二部分 投标人须知及前附表 7

第三部分 商务部分（合同条款及合同格式） 33

第四部分 用户需求书（采购内容及要求） 46

第五部分 评标办法 58

第六部分 投标文件格式 69

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



第一部分 招标公告

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
招标公告

项目概况

宫腹腔镜手术系统采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取招标文件，并于 2025 年 04 月 08 日 14 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：DXZB-2025-0312
项目名称：宫腹腔镜手术系统采购项目
采购方式：公开招标
预算金额：3200000.00 元
采购需求：

合同包 1(安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目)：
合同包预算金额：3200000.00 元
合同包最高限价：3200000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数 及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	医用内窥镜	宫腹腔镜手术系统	1 套	详见采购文件	3200000.00	3200000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：具体履行起止日期可随合同签订时间相应顺延。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3. 本项目的特定资格要求：



合同包 1(安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目)特定资格要求如下：

- (1) 具有独立承担民事责任能力的法人或非法人组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照等证明文件；
- (2) 提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证（投标人为法定代表人时，须提交法定代表人证明书）；
- (3) 投标人为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证（进口产品除外）；投标人为代理商的根据所投产品类别还需提供第二类医疗器械备案凭证或第三类医疗器械经营许可证；根据所投产品的类别出具该类产品注册证；
- (4) 所投产品为进口产品时提供完整有效的授权链；
- (5) 提供经会计师事务所审计的 2023 年财务审计报告或投标截止日前半年内任意一个月的财务报表（至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表）或银行出具的资信证明；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；
- (6) 提供投标截止日前半年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，成立不足一年的公司提供自成立后至今连续缴存社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；
- (7) 提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明，单据应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；依法免税的单位应提供相关证明材料；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；
- (8) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
- (9) 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；
- (10) 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询结果为准；
- (11) 本项目不接受联合体投标。

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



三、获取采购文件

时间：2025 年 03 月 12 日至 2025 年 03 月 18 日，每天上午 00:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025 年 04 月 08 日 14 时 00 分 00 秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

开标地点：本项目采用电子化和远程不见面开标（投标单位远程开标，无需到场），“不见面开标大厅”登录网址 <http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 在报名规定时间内使用捆绑省交易平台的 CA 锁登录安康市公共资源交易中心（<http://ak.sxggzyjy.cn/>），选择电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。

2. 本项目采用电子化与远程开标方式，投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录不见面开标大厅（网址：<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>）。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南—下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000

3. 各供应商须在招标文件获取时限内（即报名期内）登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）系统，直接下载扩展名为（*.SXSZF）的电子版招标



文件，未下载文件的供应商将无法提交电子投标文件；在报名时间截止后获取招标文件的供应商视同为无效；

4. 请各投标人购买招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

5. 需要落实的政府采购政策：

（1）财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（2）财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（4）财政部 发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购品目清单〉的通知》（财库〔2019〕19号）

（5）财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

（6）财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（7）财政部 农业农村部 国家乡村振兴局《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（8）国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（9）陕西省财政厅《关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、陕西省财政厅《关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

（10）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



(11) 陕西省财政厅《关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》
(陕财办采〔2023〕4号)。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：安康市人民医院

地址：安康市江北大街 38 号

联系方式：0915-3368383

2. 采购代理机构信息

名称：陕西德信招标有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区南二环东段凯森盛世 B 座四层

联系方式：029-82694900 转 9021

3. 项目联系方式

项目联系人：李敏、周菊

电话：029-82694900 转 9021、9022

陕西德信招标有限公司

2025 年 3 月 11 日

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



第二部分 投标人须知及前附表

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



一、投标人须知前附表

本表关于招标货物及有关服务的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	内 容
1.	买方名称：安康市人民医院 地 址：安康市江北大街 38 号 联系人：李老师 联系电话：0915-3368383
2.	招标代理机构：陕西德信招标有限公司 地 址：陕西省西安市雁塔区南二环东段凯森盛世 B 座四层 联系人：李敏、周菊 联系电话：029-82694900 转 9021、9022
3.	采购内容：宫腹腔镜系统 采购预算：3200000.00 元 采购数量：1 套 本项目核心产品为：全数字 4K 荧光影像平台系统 允许进口产品参与
4.	项目所属行业：工业
5.	该项目非专门面向中小企业采购。
6.	政府采购信息发布媒体（采购公告、采购结果公告、变更公告） (1) 陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址： http://ccgp-shaanxi.gov.cn/ (2) 全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）：即安康市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址： http://ak.sxggzyjy.cn/
7.	投标有效期：90 天
8.	投标语言： 中文
9.	投标报价：人民币报价，最终目的地价。
10.	评标方法：综合评分法，不保证最低价中标。

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



11.	中标服务费账户： 开户名称：陕西德信招标有限公司 开户银行：西安银行东二环南段支行 账 号：209011580000073440
12.	投标截止时间：2025 年 04 月 08 日 14 点整（北京时间）。 投标文件递交地点：安康市公共资源交易中心电子交易平台。
13.	开标时间：2025 年 04 月 08 日 14 点整（北京时间）。 开标地点：本项目采用电子化和远程不见面开标（投标单位远程开标，无需到场）， “不见面开标大厅”登录网址 http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/logi
14.	（1）本项目采用电子化投标方式（不见面开标系统） 投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必带数字认证证书，如因投标单位自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。 （2）制作电子投标文件 投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）http://www.sxggzyjy.cn/的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。” （3）递交电子投标文件 登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台 — 陕西政府采购交易系统 — 企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务 — 我的项目 — 项目流程 — 上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 （4）开标签到 投标单位等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后将无法签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前 30 分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。 （5）注意事项 ①为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



	省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为： https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）。 ②建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 30 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。 ③及时关注右侧公告及互动栏目信息。
15.	投标文件的提交： 在《安康市公共资源交易中心》投标截止日前上传加密的电子投标文件（扩展名为 “.SXSTF” ）。 项目开标结束后，中标供应商在领取中标通知书时提供一正二副纸质投标文件用于备案。
16.	（1）技术偏离表不得完全复制粘贴招标文件技术参数要求，否则视为无效投标。 （2）技术偏离表响应内容须提供相关技术支持资料；技所提供的资料须清晰反应关键内容，未按要求提供的视为无效资料，不予认可。 （3）所提供的支持资料应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由投标人自行承担。 （4）投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。 说明：相关技术支持资料包括产品技术说明书、国家认可的第三方检测报告、产品官方网站截图、技术白皮书等。如不提供，引起的一切后果，投标人自行承担。
17.	落实的政府采购政策： （1）对小型或微型企业参加政府采购投标的扶持： 根据财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；供应商可在投标文件中提供小型和微型企业声明； （2）对监狱企业、残疾人福利企业的扶持： 根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财



	库〔2014〕68号）（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）、财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对监狱企业、残疾人福利企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审； 对同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复享受政策。 （3）对节能、环保政策的支持 ①根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部 发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购品目清单〉的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，若投标货物属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ②根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，若投标货物属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 ③产品同时属于“非强制采购节能产品”、环境标志产品的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（供应商自行选择，并在报价文件中填写相关信息及数据）。
18.	强制认证产品说明： 所投产品属于国家强制认证产品的应获得强制认证且证书在有效期内，否则不得投标。不论查验与否，提供本应获得而未获得 CCC 认证产品的投标和中标（成交）将被取消。
19.	为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案（试行）》和陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、陕西省财政厅《关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



	担保机构。中标（成交）供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标（成交）通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理。具体规定可登录陕西省政府采购网（ http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/ ）重要通知专栏中查询了解
20.	法律、行政法规规定的其他条件： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
21.	供应商注册登记提醒： 根据“陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知”，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（ http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/ ）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。
22.	供应商信用信息查询说明： 采购人、采购代理机构在供应商递交投标文件或响应文件时，在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）或中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ），查询供应商信用是否合格并记录，将查询网页、内容截图或拍照，留档保存。此查询信息仅作为本项目使用。
23.	供应商如放弃本项目投标，应在递交投标（响应）文件截止时间前一日以电子邮件形式发送至 410690238@qq.com 告知采购代理机构，否则采购代理机构可向财政部门反映情况并提供相应佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。
24.	依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第四十三条，招标过程中经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家时，经采购人书面请示政府采购管理机构同意后，现场转变采购方式为竞争性谈判，评审办法按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）规定执行。



二、投标人须知

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2. 名词解释

2.1 采购人：安康市人民医院

2.2 采购代理机构：陕西德信招标有限公司

2.3 监督管理机构：安康市财政局

2.4 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5 投标人代表：是指参加投标竞争中代表投标人的法定代表人或者是其被授权人，投标人代表是唯一的。

3. 特殊情形

3.1 特殊情形：指具有独立承担民事责任能力的非法人组织或自然人。

3.2 特殊情形规定

3.2.1 非法人组织：

①事业单位参加投标的，应参照本招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求法人代表签字处可以是事业单位的法人签章；

②分公司参加投标的（须提供总公司出具的法人授权），应参照本招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求法人代表签字处可以是分公司的负责人签字；

③个体户参加投标的，应参照本招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求法人代表签字处可以是其经营者本人签字；

3.2.2、自然人：自然人投标的，应参照本招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求盖公章处可以是自然人本人的手印；不接受自然人授权他人参加投标。

4. 招标文件

4.1 招标文件的组成

（1）招标公告

（2）投标人须知及前附表



(3) 商务部分（合同条款及合同格式）

(4) 用户需求书（采购内容及要求）

(5) 评标办法

(6) 投标文件格式

4.2 招标文件询问、质疑和投诉

4.2.1 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人、采购代理机构提出。

4.2.2 质疑

(1) 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

(2) 质疑方式：

以书面形式质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

(3) 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

(4) 在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

(5) 有下列情形之一的，属于无效质疑：

① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对



采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

4.2.3 投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）相关规定向本项目同级财政，政府采购监管部门提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

4.2.4 恶意质疑、投诉的法律后果

对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实或提供虚假材料或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

4.2.5 递交联系部门：政府采购部

联系电话：029-82694900

通讯地址：陕西省西安市雁塔区南二环东段凯森盛世 B 座四层



4.3 招标文件的澄清

投标人若对招标文件有疑问，应将要求澄清的问题以书面形式通知招标机构。

4.4 招标文件的补充和修改

4.4.1 招标机构可以用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。

4.4.2 所颁发的补充通知将于投标截止时间前发往所有购买招标文件的投标人。该补充通知作为招标文件的一部分。投标人在收到该通知后须予以签收确认。

4.4.3 考虑到补充通知的影响，委托人和招标机构可决定推迟投标截止时间。

5. 投标和招标总则

5.1 投标文件的编写

5.1.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的“投标文件格式”规定及要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

5.1.2 投标语言和计量单位

投标文件和来往函件用中文书写（外文函件必须翻译为中文），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。（除非招标文件中另有规定）。

5.1.3 投标人应按招标文件规定的投标范围进行投标。

5.1.4 投标报价：投标报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其他相关的一切费用。

5.1.4.1 供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

5.1.4.2 供应商应严格按照《投标文件格式》部分《投标报价表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

5.1.4.3 投标报价货币：人民币；单位：元。

5.1.4.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规则修正：

A. 投标文件中投标报价表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致



的，以投标报价表为准；

B. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

D. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

E. 因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

5.1.5 关于进口产品

5.1.5.1 根据财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。

5.1.5.2 根据财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，投标邀请函将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足招标文件要求的国产产品仍然可以参与竞争；否则，视为拒绝进口产品参与，供应商以进口产品参与投标时，将作无效投标处理。

5.1.5.3 优先采购向我国转让技术、提供培训服务、其他补偿贸易措施及与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的产品。

5.2 投标文件的组成

5.2.1 投标人提交的投标文件至少应包括以下部分：

- (1) 投标函；
- (2) 投标报价表；
- (3) 投标报价明细表；
- (4) 商务条款偏离表；
- (5) 技术规格偏离表；
- (6) 技术说明文件；



- (7) 法定代表人证明书或授权书；
- (8) 资格证明文件；
- (9) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
- (10) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；
- (11) 企业关联关系承诺书；
- (12) 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书；
- (13) 优惠、培训、售后服务承诺；
- (14) 项目业绩表；

缺以上任一项的投标将被视为无效投标。

5.2.2 投标人可在满足“用户需求书（采购内容及要求）”中对设备的整体要求的前提下，对设备中的软硬件配置提出合理化建议。

5.3 投标

5.3.1 本项目采用电子化和远程不见面开标（投标单位远程开标，无需到场），“不见面开标大厅”登录网址：

<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>

5.3.2 纸质版响应文件仅需中标投标人提交，在领取中标通知书时提供用于备案。

5.3.3 纸质版投标文件一式叁份，其中正本壹份，副本贰份。在每一份文件上要注明“正本”或“副本”字样。

5.3.4 投标文件的正本需打印，并由法定代表人或经正式授权的代表在投标文件上签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

5.3.5 投标人名称应当填写全称，同时加盖公章。

5.3.6 纸质版投标文件不得随意涂改和增删，应当跟开标时上传的电子投标文件一致。任何行间如有修改错漏之处，涂改或增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签字、盖章才有效。

5.3.7 投标人应当按照招标文件中提供的统一格式制作投标文件，投标文件中应当有目录。



5.3.8 纸质版投标文件必须工整、规范、统一、清晰，采用A4幅面纸胶装成册、标注页码。

5.3.9 若投标人对文件理解有误，产生的后果由投标人自行承担。

5.4 投标的有效期

从投标截止日期起，投标有效期为 90 天。在特殊情况下，招标机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式。

5.5 合同签订后请将合同复印件一份送至代理机构或将扫描件发至采购代理机构邮箱：410690238@qq.com，以便及时归档。

5.6 投标文件的修改：

在规定的时间内，投标人可以修改其投标文件的内容，但必须以书面形式通知招标机构。在招标规定的修改截止时间后，投标人不可以修改其投标文件的内容。

5.7 投标的撤回

在投标截止时间前投标人可以撤回其投标，但在投标截止后不允许撤回投标。

5.8 招标过程及评审

5.8.1 招标机构将在招标公告中规定的时间和地点接受投标。

5.8.2 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评审。

5.8.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件将视为无效投标。出现但不限于下列情况之一的，其投标将视为无效投标：

- (1) 投标文件不完整的；
- (2) 投标文件无法人代表签字或签字人未被法人授权的；
- (3) 投标有效期不足的；
- (4) 投标文件附有招标方不能接受条件的；
- (5) 投标总价超出项目预算或明显高于市场价格的；
- (6) 按招标文件要求其他不符合招标方要求的。

5.8.4 评标委员会将按已定的原则及方法进行评审，详见评标办法。

5.8.5 评标委员会在确定中标候选人以前有权按照有关法规拒绝任何或全部投标，对此造成对投标人的影响不负任何责任，不做任何解释。

5.8.6 确定中标人后，由招标机构发出中标通知书，中标人应 25 日内与采购人



签约。

5.8.7 招标机构没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

5.9 招标、评标过程的保密性。

5.9.1 接受投标后，直至中标商与买方签订合同后止，凡与招标、审查、澄清、评价、比较、授标意见有关的内容，任何人均不得向投标人及与评审无关的其他人透露。

5.9.2 从投标截止日起到确定中标人止，投标人不得与参加招标、评审的有关人员私下接触。在评审过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面对参与评审的有关人员和买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

5.9.3 关于同一品牌产品的处理

5.9.3.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

5.9.3.2 非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

5.10 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造；工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承接（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。否则其投标将被认定为投标无效。

6. 签约及中标服务费

6.1 中标人须向招标机构缴纳足额中标服务费并领取中标通知书。

6.2 中标人须向招标机构按如下标准和规定交纳中标服务费：

- （1）中标服务费币种与中标通知书中标价的币种相同；
- （2）中标服务费不列在投标报价表中；
- （3）招标代理服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行



办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定向中标（成交）供应商收取。

6.3 合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

6.3.1 签订政府采购合同

6.3.1.1 自中标通知书发出之日起25日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。

6.3.1.2 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

6.3.1.3 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

6.3.1.4 质疑或者投诉事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

6.3.2 合同公告及备案

6.3.2.1 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

6.3.2.2 采购人应自合同签订之日起7个工作日内将政府采购合同报送监管机构备案。

6.3.3 履行合同

6.3.3.1. 合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

6.3.3.2. 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。



6.3.4 验收或考核

6.3.4.1 采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。

6.3.4.2 采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

7. 陕西省中小企业政府采购信用融资办法及说明

陕西省中小企业政府采购信用融资办法

第一条 为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。根据《政府采购法》以及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条 本办法所称“中小企业”包括中型、小型及微型企业，其划型标准按照《工业和信息化部 统计局 发展改革委 财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

第三条 本办法所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

第四条 开展政府采购信用融资的银行，应当为在陕西省境内注册或设立分支机构，并经财政部门审核且在我省政府采购信息系统搭建服务链接窗口的金融机构。

第五条 政府采购信用融资应当坚持“财政引导，市场运行，银企自愿，互惠共赢”的原则。

第六条 省财政厅以全省统一的电子化政府采购系统为平台，对接银行信息化系统，推进政府采购中标成交信息、合同信息、融资信息、支付信息和信用信息等信息资源共享。

第七条 各级财政部门应当以政府采购诚信考核和信息化建设为基础，积极为



中小企业信用融资搭建平台，提供银企对接的机会和相关的服务支持，但不得为相关贷款项目提供任何形式的担保。

第八条 各银行可自主决定是否提供政府采购信用融资以及融资额度，并与供应商签订融资协议；各供应商也可自行决定是否参加政府采购信用融资，并自愿选择合适的融资银行及在该银行开设银行账户。任何单位和个人均不得干预银企双方开展政府采购信用融资业务。

第九条 政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

第十条 银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

第十一条 中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

第十二条 银行应按规定对申请信用融资的供应商的政府采购合同信息进行审查，必要时可通过陕西政府采购网对该政府采购合同进行审核，以确保政府采购合同的真实性和有效性。

第十三条 对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

第十四条 各银行应当建立政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，简化贷款审批程序，制定相应业务管理规范，审核无误后，银行应当凭合同和事先约定的优惠利率及时予以放款，提供快捷、方便、专业的融资服务。

第十五条 省本级政府采购资金支付时，各采购单位必须将采购资金支付到备案合同中指定的融资银行及收款账号，以保障贷款资金的安全回收。



第十六条 各市县操作程序由各地结合本地实际自行拟定，但应当体现“便捷高效、监管有效、风险可控”的原则。

第十七条 供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或无故不及时还款的，或出现其他违反本办法规定情形的，除按融资合同约定承担违约责任外，同级财政部门应当将其行为按“不良行为”记入供应商诚信档案；情节严重的，应记入供应商“黑名单”；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第十八条 本办法由陕西省财政厅负责解释。


供应商融资申请操作手册

政府采购合同融资是指在地方财政部门引导下，参与政府采购中标（成交）的供应商可凭政府采购合同向银行申请信用融资，银行按优于一般中小企业贷款利率发放贷款的融资模式。这种融资模式以国库集中支付作为履约保障的政府采购合同为基础，借力政府采购诚信保障，提供了银企对接的机会，缓解了企业融资困境。


政府采购合同融资申请获批的必要条件是，供应商将意向申请银行指定的资金受监管账户签入采购合同，获得银行认可，以保障银行回收贷款路径安全。企业可在签署采购合同前完成意向申请银行开户，并将开户账号签入采购合同作为唯一收款账户；如申请融资时已签署采购合同的，企业应将意向申请银行开户账号通过采购合同变更的方式，将开户账号签入采购合同作为唯一收款账户，无论哪种情况，最终的采购合同都需要获得银行的认可，才能获得银行的正式授信。



业务流程简图如下：

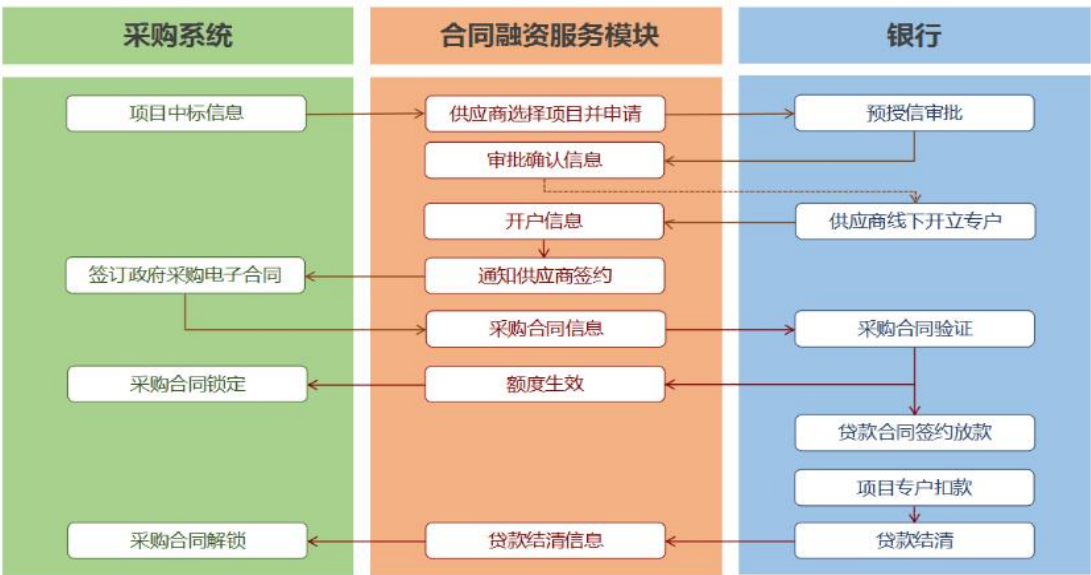

未签订采购合同申请流程

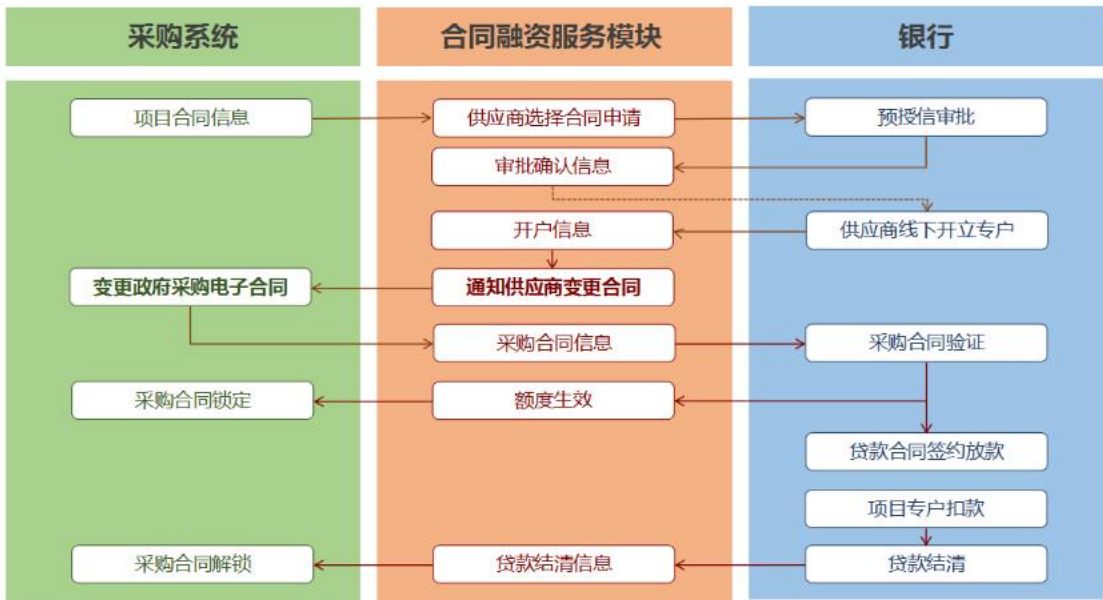

已签订采购合同申请流程

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



陕西省政府采购支持中小企业信用融资合作银行目录（参考）

序号	银行名称	授信额度	贷款期限	贷款利率
1	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	融资申请人为公司的额度不低于 300 万元； 融资申请人为个人的，额度不高于（含）300 万元； 单笔额度不高于订单金额的 70%	最长不超过（12）个月或（360）天	1、不超过中小企业同期市场利率水平 2、利率浮动区间（1 年期 LPR-1 年期 LPR+194bps）
2	中国建设银行陕西省分行	根据单笔政府采购合同金额核定，最高融资金额为合同金额的 90%	最长不超月或（360）天或（12）个月	不超过中小企业同期市场利率水平 2、利率浮动区间（4.5%—5%）
3	中国光大银行股份有限公司西安分行	原则上单户贷款金额最高不超过 1000 万元	最长不超过 12 个月	不超过中小企业同期市场利率水平
4	中信银行股份有限公司西安分行	最高 1000 万元	最长不超过 12 个月	不超过中小企业同期市场利率水平
5	北京银行股份有限公司西安分行	不超过 1000 万元，我行依据中标供应商通过政府公开招标程序中中标并执行的采购合同，通常提供不超过采购资金缺口 70%的额度，对于优质客户可放宽至 80%（采购资金缺口=合同金额-已付/预付货款-质保金）	2 年期综合授信（提前期 1 年，每笔业务期限不超过 1 年）	不超过中小企业同期市场利率水平
6	平安银行股份有限公司西安分行	最高 500 万元	最长不超月或（360）天或（12）个月	利率浮动区间（6%—8%）
7	兴业银行股份有限公司西安分行	不超过 1000 万元（首次申贷客户不超过 500 万元）	最长不超过（12）个月或（/）天	不超过中小企业同期市场利率水平
8	陕西秦农农村商业银行股份有限公司	最高授信额度 1000 万元	原则上不超过 1 年，最长不超过 2 年	不超过中小企业同期市场利率水平

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



9	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	经营快贷一政采贷单户不超过 500 万元且不超过订单金额的 90%，线上供应链根据订单和应收贷款合理确定贷款额度。	最长不超过(36)个月或 3 年	1、按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率(LPR)确定；2、利率浮动去电（最高不超过 LPR+50bp）
10	招商银行股份有限公司西安分行	最高 3000 万元	非工程类不超过 1 年，工程类不超过 3 年	不超过中小企业同期市场利率水平
11	浙商银行股份有限公司西安分行	最高不超过 1000 万	最长不超过(36)个月	利率浮动区间（依据总行利率指导价执行）
12	中国银行陕西省分行	中标合同金额 70%，最高 1000 万元	最长不超过(24)个月	不超过中小企业同期市场利率水平
13	中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省分行	300 万元	最长不超过(12)个月或(360)天	不超过中小企业同期市场利率水平，利率浮动区间为 3.85%—5.95%
14	西安银行股份有限公司	300 万元	最长不超过(36)个月	不超过中小企业同期市场利率水平
15	中国民生银行股份有限公司西安分行	最高 500 万元	最长不超过(12)个月	不超过中小企业同期市场利率水平
16	中国农业银行股份有限公司陕西省分行	3000 万元以下	最长不超过(12)个月	不超过中小企业同期市场利率水平，利率浮动期间（3.85%—4.35%）
17	浙江网商银行股份有限公司	上限 1000 万	一年	5%—7%
18	平安银行股份有限公司	上限 1000 万	一年	5%—9%

注：以上银行合作有效时间及授信额度、贷款期限、贷款利率仅供参考，具体规定可登录陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）重要通知专栏中查询了解。



8. 安康市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容

8.1、关于需要特别提醒供应商的内容

8.1.1、本项目采用电子化投标的方式，供应商须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

8.1.2、因投标人（含供应商、投标人、竞买人等）自身问题，电脑遭遇网络堵塞、病毒入侵、硬件故障或者数字证书遗失、遗忘等原因导致不能正常参与电子交易活动的，后果由投标人承担。

8.1.3、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）

（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。

8.1.4、标书雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心 2021 年 7 月 22 日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如 MAC 地址、硬盘序列号、CPU 编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18 号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

8.1.5、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

8.2、关于报名

8.2.1、购买须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；

8.2.2、未完成网上投标成功的或未在规定时间内在平台上下下载文件的，无法完成后续流程；

8.2.3、本项目采用电子化投标的方式（落实无纸化交易，无需提供纸质版文件），相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南—下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

8.2.4、电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。

8.3、关于文件的制作和签名

8.3.1、为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子化投标的方式（落实无纸化交易，无需提供纸质版文件）。

8.3.2、编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

8.3.2.1 电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台—企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程—交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程—答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

8.3.2.2 电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南—下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）》，下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-80>

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



6289d7cf3b.html，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南—下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》，下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html>;

8.3.2.3 制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

8.4、关于响应文件递交与解密

8.4.1. 文件递交

8.4.1.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台—企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页）电子交易平台）企业端）我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

8.4.2. 文件开启与解密

8.4.2.1 开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在开标室的解密机上自行解密电子投标文件。涉及二次报价的，一定携带主锁报价，只有主锁才有签章功能，二次报价才能完成。

8.4.2.2 电子开标失败时，由于投标人（含供应商、投标人、竞买人等）自身问题，电脑遭遇网络堵塞、病毒入侵、硬件故障或者数字证书遗失、遗忘等原因导致不能正常参与电子交易活动的，后果由投标人承担。

8.4.2.3 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：

- a. 供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
- b. 因供应商自身原因（如未带 CA 锁或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法



解密投标文件的；

c. 上传的电子投标文件无法打开的；

d. 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

8.4.2.4 特殊情形下的应急处置

参照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》
第五条 出现以下情形的，可延续电子开评标流程：

（一）在开评标过程中出现硬件设备（包括电脑、打印机、投影仪等）故障导致招标代理机构无法使用进行正常开评标的，代理机构应及时与公共资源交易中心工作人员联系，通知交易中心信息技术保障人员迅速判断、检查、排除设备故障，修理或更换有问题的设备。故障在 2 小时内可修复的，可延续电子开标评标流程。

（二）出现电子交易系统和网络异常情况，导致代理机构无法进行正常开评标时，代理机构要及时联系交易中心信息技术保障人员迅速判断、及时排除系统信息故障。首先可尝试使用无线、移动数据等其他应急网络继续开评标。若更换网络或简单维修后，仍无法正常进行的，应联系电子政务办，将电子政务外网转换为内网运行。故障在 2 小时内可修复的，可延续电子开标评标流程。

（三）交易中心出现临时停电断电的紧急情况，代理机构应及时通知交易中心的后勤保障服务人员，迅速查找停电原因，进行修理尽快恢复供电。故障在 2 小时内可修复的，可延续电子开标评标流程。

第六条 2 小时内无法修复的，由代理机构根据招标人意见，可按照以下解决方案进行。

方案一：延续电子开评标流程。经招标人同意后，由代理机构向交易中心出具电子开评标情况说明，并由招标人、代理机构、评审专家等相关人员签字盖章，确定新的开评标时间，待故障排除后再继续完成电子开评标流程。

方案二：另行择期开评标。由招标人征求所有投标人同意，并报监管部门备案后公布。待故障修复后，由招标代理原文发布至统一交易平台，重新确定时间开评标。重新开评标时间自补充通知之日起不少于 1 个工作日。

第七条 故障修复期间，招标人、代理机构等相关人员要严格做好开评标信息保密工作，同时安排评标专家至休息地点等候，待故障修复后继续在指定

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



地点开标、评标。评标专家有特殊情况确实不能继续参与评标的，予以补抽专家。择期另行开评标的，评标专家需重新抽取。

8.4.2.5 延时情况说明由代理机构将突发情况的原因、经过、解决措施，延长时间等进行详细准确的书面记录，再由招标人和代理机构等相关人员签字确认。

8.4.2.6 采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。



第三部分 商务部分（合同条款及合同格式）

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，， 买方有权在签订合同同时对合同的相关条款及内容做进一步的细化和修改。）



商务部分

一、合同专用条款

本表关于招标货物和服务的具体要求是对本合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。

序 号	内 容
1.	买方（采购人）名称：安康市人民医院
2.	卖方名称：
3.	交货期：自合同签订之日起 90 个工作日内交货。
4.	质保期：1 年
5.	付款方法和条件：货到安装，调试，验收完成后付合同金额的 30%，半年后付合同金额的 60%，一年后付合同金额的 10%。
6.	应提供的伴随服务： 选所有
7.	交货地点：安康市人民医院指定地点。
注：以上要求不可负偏离，否则视为无效投标。	



二、合同通用条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

- 1) “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
- 2) “合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。
- 3) “货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、硬件设备、软件和其他材料。
- 4) “服务”系指根据本合同规定卖方承担与本项目有关的技术开发及服务。如运输、保险以及其他的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。
- 5) “合同条款”系指本合同条款。
- 6) “买方”系指在合同专用条款中指定的购买货物和服务的单位。
- 7) “卖方”系指在合同专用条款中指定的提供合同项下货物和服务的公司或其他实体。
- 8) “项目现场”系指本合同项下本项目安装、运行的现场，其名称在合同专用条款中指明。
- 9) “天”指日历天数。

2. 适用性

本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3. 标准

3.1 本合同下交付的服务应符合“用户需求书（采购内容及要求）”要求所述的标准。如果没有提及使用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

3.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4. 使用合同文件和资料

4.1 卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、



计划、图纸、模型、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

4.2 除了履行本合同外，卖方不应使用合同条款 4.1 条所列举的任何文件和资料。

4.3 除了合同本身以外，合同条款第 4.1 条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

5. 专利权

卖方应保证，买方使用该货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

6. 服务

卖方（中标人）必须负责系统集成，包括但不限于设计、安装、调试、培训、验收及售后服务。

7. 伴随服务

7.1 卖方可能被要求提供下列货物和服务中的所有服务，包括“合同专用条款”与“采购内容及要求”规定的附加服务：

- （1）实施所供服务的系统集成和试运行；
- （2）提供货物组装和维修所需的工具；
- （3）为所供本项目提供详细的操作和维护手册；

（4）在双方商定的一定期限内对本项目实施运行维护和修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同质量保证期内所承担的义务；

7.2 卖方提供的上述伴随服务均应含在合同总价中，买方不再为其单独一项或数项另外支付费用。

7.3 卖方应提供“合同专用条款”和“用户需求书（采购内容及要求）”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8. 保证

8.1 在质量保证期内所发现的缺陷，买方应尽快以书面方式通知卖方。

8.2 如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规



定对卖方行使的其他权力不受影响。

8.3 卖方对故障或缺陷的处理结果应使买方满意。

8.4 交货期：自合同签订之日起 90 个工作日内交货

9. 索赔

9.1 如果卖方对偏差负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

(1) 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回产品所需的其他必要费用。

(2) 根据产品的偏差情况、损坏程度，以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低产品的价格。

(3) 用符合合同规定的品牌、规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一节费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

9.2 如果在买方发出索赔通知后十五（15）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后十五（15）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款中扣回索赔金额。

10. 付款

本合同项下的付款方法和条件在“合同专用条款”中有规定。

11. 价格

卖方在本合同项下提交产品和履行服务的价格在合同中给出。

12. 变更指令

12.1 买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

(1) 本合同项下提供的产品是为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

(2) 运输或包装的方法；

(3) 交货地点；



(4) 卖方提供的服务。

12.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后十五（15）天内提出。

13. 合同修改

除了合同条款第 12 条的情况，不对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

14. 转让

未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

15. 分包

对招标文件中没有明确分包的内容，卖方在未取得买方书面同意的通知，不得擅自进行分包，但分包通知并不能解除卖方履行本合同的任何责任和义务。

16. 卖方履约延误

16.1 卖方应按照招标文件中规定的时间交货和提供服务。

16.2 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

16.3 除了合同条款第 19 条的情况外，卖方完工延误，将按合同条款第 19 条的规定被收取误期赔偿费。

17. 误期赔偿费

除合同条款第 19 条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的工期完工，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟完工工程部分或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至完工或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第 20 条的规定终止合同。

18. 违约终止合同



18.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款规定同总延长的期限内完成部分或全部工程。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

(3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件。

(a) “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

(b) “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

18.2 如果买方终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

19. 不可抗力

19.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

19.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续六十天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

20. 因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。



21. 因买方的便利而终止合同

21.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

21.2 对卖方收到终止通知后十五（15）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

（1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受。

（2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

22. 争议的解决

22.1 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商开始后三十（30）天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。仲裁地点为安康仲裁委员会。

22.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

22.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

22.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

23. 合同语言

本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函均用中文书写。

24. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25. 通知

25.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式传真送到“合同专用条款”中规定的对方的地址。传真需经书面确认。

25.2 通知以送达日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

26. 税款

26.1 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需缴纳的与本合同有关的一切税旨均应由买方负担。

26.2 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需缴纳的与本合同

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



有关的一切税旨均应由卖方负担。

27. 合同生效及其他

27.1 本合同经买卖双方及招标单位授权代表签字盖章后生效。

27.2 如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。

27.3 本合同具有法律效力，受国家法律保护。

27.4 本合同一式伍份，买方（使用单位）贰份，卖方贰份，招标代理机构壹份。



三、合同格式（参考）

医疗设备采购合同

采购方(甲方)：_____ 供货方(乙方)：_____

住所地：_____ 住所地：_____

法定代表人：_____ 法定代表人：_____

电 话：_____ 电 话：_____

甲方通过招标采购方式，最终确定乙方为_____项目的中标人，乙方是甲方采购_____设备项目的供应商。甲乙双方协商，并根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定，在平等互利、协商一致的基础上，双方自愿达成如下协议：

第一条 设备明细表如下(或见附件)：

货物名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价	总价

乙方应随货提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、检验合格证、服务指南等。

第二条 技术标准

在符合招标文件采购需求和技术要求以及国家相关技术标准的基础上，甲、乙双方根据投标文件、技术标准和规范及本合同约定进行技术验收；甲方验收合格后，双方在《验收合格证单》上签字确认。

第三条 供货时间及交付地点：

1. 乙方在合同生效的_____天内向甲方交付上述设备。



2. 乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担运费、保险费、税费及设备的安装调试。

第四条 安装和验收（附件 1 设备验收合格单）：

1. 设备到货后，乙方应在接到甲方通知后____天内安装调试完成。
2. 甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

第五条 货款及支付方式

1. 合同总价为人民币：（大写）_____；（¥：_____）
2. 设备验收合格后支付合同总金额的____%，设备正常运行____个月后支付合同总金额的____%。；
3. 余款____年后无质量问题无息一次性付清。

第六条 售后服务及质量保证

1. 乙方对货物实行三包（包修、包换、包退）。
2. 乙方自收到甲方电话、传真等维修要求后应当在__小时内响应，__小时内解决问题；逾期甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。
3. 整机免费质保期为__年，自设备安装调试合格之日起算。在免费质保期内，乙方履行保修义务应免收材料和人工等一切费用；免费质保期满后，乙方履行保修义务只收取人工费。
4. 设备运至甲方指定处，乙方应指派技师对甲方操作人员安装、使用设备进行培训，直至甲方操作人员能熟练操作为止，乙方承担培训技师的薪资、差旅等全部费用。

第七条 违约责任

1. 甲方逾期支付货款满一个月后，每日按逾期未付金额的____%向乙方支付违约金。
2. 非乙方供货质量问题，甲方中途不得退货。
3. 乙方逾期供货，每逾期一日，按合同总金额的____%向甲方支付违约金。
4. 乙方逾期供货超过 30 日，甲方有权解除合同，并按合同总金额的____%向甲方支付违约金。
5. 乙方违反质量条款交付产品，乙方应在甲方书面通知七日内提供符合约

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



定质量标准的产品，每逾期一日承担合同金额__%的违约金。

第八条 不可抗力

甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第九条 争议解决方法

甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商；如协商未果的，任何一方均有权将争议向合同签订所在地人民法院提起诉讼。

第十条 其他

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式__份，甲、乙双方各执__份，自双方签字、盖章之日生效。

3、乙方指定专人（姓名：____，电话：____通讯地址：____）作为本次项目的负责人、对接人和联络人，负责与甲方协调、沟通履行本合同过程中的相关事宜，并作为乙方指定接收甲方法律文书、函件、通知等内容的专职负责人，如该指定专人发生变更、乙方应在发生变更后三日书面通知甲方，未书面通知的由此造成的法律后果均由乙方承担。

甲方：（盖章）_____	乙方：（盖章）_____
法定代表人或代理人：_____	法定代表人或代理人：_____
日期：_____	日期：_____

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



附件 1. 设备验收合格单

供货商名称		供货商负责人	姓名：6100000216228				
			电话：				
安装工程师		电话					
安装地点		完工日期					
验收设备清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具及数量（可附表，但验收人必须在附表签字）							
序号	设备名称	规格型号及性能参数	单位	数量	单价（元）	合计（元）	安装详细地点
				合计：			
验收意见	以上设备经供应商安装调试完成，现经我单位按照合同要求进行验收，意见如下：设备的品牌、外观、规格、数量、配件（是、否）正确，经安装调试后设备运行（是、否）正常，技术资料（是、否）齐全，验收（是、否）合格。 采购单位验收人签名： 采购单位科室主任/护士长签名： 验收日期： 年 月 日						
备注							

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



第四部分 用户需求书（采购内容及要求）



全数字 4K 荧光宫腹腔镜系统配置及参数（妇科）

一、采购内容

序号	货物名称	数量	备注
1	全数字 4K 荧光影像平台系统	1 套	核心产品
2	LED 医用光源	1 套	
3	液体膨宫泵	1 套	
4	40L 电子气腹机	1 套	
5	腹腔镜及导光束	1 套	
6	宫腔双极电切镜系统	1 套	
7	宫腔检查镜及手术器械	3 套	
8	妇科宫内刨削系统	1 套	
9	电外科能量平台系统	1 套	
10	腔镜台车	1 套	
11	图文工作站	1 套	

二、设备配置要求

1. 全数字 4K 荧光影像平台系统		
序号	货物名称	数量
1.1	全数字 4K 荧光影像平台系统	1 套
1.2	全数字 4K 荧光摄像头	1 套
1.3	32"医用监视器及底座	1 套
2. LED 医用光源		
2.1	LED 医用光源	1 套
3. 液体膨宫泵		
3.1	液体膨宫泵	1 套
3.2	可重复使用膨宫软管	2 套
4. 40L 电子气腹机		

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



4.1	40L 电子气腹机	1 套
5. 腹腔镜及导光束		
5.1	30° 腹腔镜	1 根
5.2	30° 荧光腹腔镜	1 根
5.3	4.8mm 纤维导光束	1 根
5.4	3.5mm 导光束	1 根
6. 宫腔双极电切镜系统		
6.1	4mm 电切镜	1 根
6.2	电切镜鞘	1 套
6.3	电切镜鞘鞘芯	1 把
6.4	电切镜手件	1 套
6.5	双极电切环	12 根
6.6	双极电凝针	6 根
6.7	双极高频电缆	1 根
7. 宫腔检查镜及手术器械		
7.1	2.9mm 宫腔镜	3 根
7.2	连续冲洗操作鞘	3 把
7.3	操作鞘	3 把
7.4	软性活检钳	1 把
7.5	软性剪刀	1 把
7.6	软性抓钳	1 把
8. 妇科宫内刨削系统		
8.1	宫内刨削内镜	1 把
8.2	操作鞘	1 把

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



8.3	中空鞘芯	1 把
8.4	刨削手件	1 把
8.5	把手	1 把
8.6	刨削刀头（长方形窗口）	1 套
8.7	刨削刀头（卵圆形窗口）	1 套
8.8	刨削动力主机系统	1 套
8.9	冲洗吸引主机系统	1 套
8.10	硅胶吸引管	1 套
8.11	控制电缆	1 根
8.12	持针器	1 把
8.13	剪刀，尖头	1 把
8.14	剪刀	1 把
8.15	抓钳	1 把
8.16	活检钳	1 把
8.17	专用消毒盒	1 个
9. 电外科能量平台系统		
9.1	电外科能量平台系统	1 套
10. 腹腔镜台车		
10.1	腹腔镜台车	1 台
11	图文工作站	
11.1	宫腹腔镜图文工作站	1 套



三、技术要求

★提供“进”字号医疗器械注册证。
1. 全数字 4K 荧光影像平台系统
1.1 全数字 4K 荧光影像平台主机：
★1.1.1 摄像系统分辨率 4K（3840*2160）；具备荧光功能；
1.1.2 逐行扫描，三晶片 CMOS 传感器；
1.1.3 主机集成图文工作站功能，可通过摄像主机术中全高清录像及超高清图片拍照，无需添加额外设备；
1.1.4 主机可同时进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示；
★1.1.5 可连接腹腔镜、宫腔镜、电切镜等，进行双镜联合手术，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示；
★1.1.6 可连接同品牌多种电子镜和纤维软镜，如：4K3D 荧光一体电子腹腔镜、电子膀胱镜、电子输尿管镜、电子鼻咽喉镜、电子支气管镜、纤维膀胱镜、纤维输尿管镜、纤维胆道镜等；
1.1.7 具备≥2 种腔镜光谱分析处理模式；
1.1.8 成像模式：有白光模式、近红外光模式。其中近红外光模式≥4 个子模式；
1.1.9 摄像主机能实现≥4 种同屏显示模式；
1.1.10 具有纤维镜图像优化功能；
1.1.11 术野画面≥5 级亮度可调；
1.1.12 术野画面可实现上下、左右及 180° 翻转功能；
1.1.13 影像平台主机≥4 个 USB 接口，可通过接口，将数字录像直接存储于 U 盘；
1.1.14 输出端口：DP 数字端口≥2 个，12G/3G-SDI 数字端口≥1 个，DVI-D 数字端口≥1 个；
1.1.15 电气安全：医用设备电气安全 CF 级别 I 类防护；
1.1.16 支持 50Hz 和 60Hz 输出。
1.2 4K 荧光摄像头

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



1.2.1 采集像素：摄像头像素 $\geq 3840 \times 2160$ ，逐行扫描；
1.2.2 重量 $\leq 260\text{g}$ ；
1.2.3 图像格式 16:9；
1.2.4 可同时采集可见光波段及近红外波段；
1.2.5 全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输；
1.2.6 可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源；
★1.2.7 摄像头 3 个按键可设置 ≥ 4 种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、荧光模式切换、荧光开关；
1.2.8 术野画面放大功能， ≥ 7 级可调，具备自适应缩放功能；
1.2.9 电气安全：I 类 CF 型医用设备。
1.3 医用显示器监视器
1.3.1 种类 16：9 医用专业液晶显示器；
1.3.2 尺寸 $\geq 32"$ ；
1.3.3 分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ ；
1.3.4 数字接口：DP 数字端口、12G-SDI 数字端口、DVI-D 数字端口、HDMI 2.0 数字端口、HDMI 1.4 数字端口；
1.3.5 视角 $178^\circ / 178^\circ$ ；
1.3.6 具备进口品牌。
2. 医用冷光源
2.1 具有 ICG 荧光；
2.2 操作方式：控制面板为彩色液晶显示屏，在液晶显示屏上可显示语言文字操作模式，其中含有中文操作系统；
2.3 LED 光源；
2.4 具备待机及自动存储功能；
2.5 色温 $\geq 5700\text{K}$ ；
2.6 灯泡寿命 ≥ 30000 小时；
2.7 电气安全：CF 型医用设备；
2.8 具备单踏板脚踏。



3. 液体膨宫泵
3.1 最高流速 $\geq 1000\text{mL}/\text{min}$;
3.2 手动、自动两种模式;
3.3 可与妇科动力主机实现双机联动;
3.4 可用于宫腔镜下吸引, 腹腔镜下冲洗或吸引;
3.5 配备冲洗管路及吸引管路, 可高温高压消毒;
3.6 触摸屏, 防水面板可擦拭消毒;
3.7 兼容一体化手术室;
3.8 可重复使用液体膨宫管 2 套。
4. 电子气腹机
4.1 气腹压力范围 1-30 mmHg, 可调;
★4.2 气腹流量 $\geq 40\text{ L}/\text{min}$;
4.3 高速灌流模式: 适用于成人, 流速调节范围: 1-40 L/min;
★4.4 高精给灌流模式: 适用于儿童, 压力调节范围: 1-15mmHg; 流速调节范围: 0.1-15L/min。当流速调节范围为: 0.1-2 L/min 范围, 调节精度为 $\leq 0.1\text{ L}/\text{min}$; 当流速调节范围为 2-10 L/min 范围, 调节精度为 $\leq 0.5\text{ L}/\text{min}$;
4.5 自动压力调节装置;
4.6 集成安全系统, 可快速检测压力过高情况;
4.7 电气安全: CF 型医用设备。
5. 腹腔镜及导光束
5.1 腹腔镜
5.1.1 腹腔镜采用原装进口腹腔镜视管, 蓝宝石镜面;
5.1.2 镜体成像角度 30° , 直径 $\leq 10\text{mm}$, 长度 $\geq 30\text{cm}$;
5.1.3 可高温高压、浸泡、熏蒸灭菌。
5.2 荧光腹腔镜
5.2.1 镜体结构: 超广角, 无失真;
5.2.2 镜面材质采用蓝宝石;
5.2.3 柱状镜体, 适用于荧光腹腔镜手术;



5.2.4 镜体成像角度 30°，直径≤10mm，长度≥30cm；
5.2.5 可高温高压、浸泡、熏蒸灭菌；
5.2.6 纤维导光束：直型接头，直径≤4.8mm，长度≥300cm；
5.2.7 配腹腔镜消毒盒。
5.3 纤维导光束
5.3.1 直径≤4.8mm，长度≥250cm，耐高温；
5.3.2 直径≤3.5mm，长度≥230cm，耐高温。
6. 宫腔双极电切镜
6.1 宫腔双极电切镜
6.1.1 镜体结构：超广角，无失真；
6.1.2 镜面材质：采用蓝宝石；
6.1.3 电切镜：镜体成像角度 12°，直径≤4mm，长度≥30cm；
6.1.4 可高温高压、浸泡、熏蒸灭菌。
6.2 双极电切镜及器械
6.2.1 电切镜鞘包括：抽吸、冲洗连接管，2 个 LUER 锁连接器，直径 8 mm，斜嘴，可转动陶瓷绝缘内套管；
6.2.2 具备鞘芯；
6.2.3 电切镜手件，：双极指环控制工作手件。非工作状态时电极在镜鞘内；
6.2.4 双极电切环，环形电极，24Fr.，带角度；
6.2.5 双极电凝针，24Fr.，针状；
6.2.6 双极高频电缆，用于双极电切镜配套使用。
7. 宫腔检查镜及手术器械
7.1 宫腔检查镜及宫腔镜鞘
7.1.1 镜体结构：超广角，无失真；
7.1.2 镜面材质：采用蓝宝石；
7.1.3 镜体成像角度 30°，直径≤3.0mm，长度 30cm；
7.1.4 可高温高压、浸泡、熏蒸灭菌；
★7.1.5 双操作鞘设计，外径≤4.3mm，带 5Fr 器械通道，头端泪滴设计；



★7.1.6 连续灌流鞘，鞘口卵圆形设计，免扩宫（外鞘≤5mm），分别独立的进出水通道，配合操作鞘使用。
7.2 宫腔检查镜手术器械
7.2.1 软性活检钳，勺形活检钳，5 Fr.，长≥34 cm，双动钳夹，半硬性；
7.2.2 软性剪刀，钝，5 Fr.，长≥34 cm，单动钳夹；
7.2.3 软性抓钳，活检抓钳，5 Fr.，长≥34 cm，软性，双动钳夹。
8. 妇科宫内刨削系统
8.1 宫内刨削内镜
8.1.1 柱状晶体镜，非球面镜，蓝宝石镜面；
8.1.2 平行目镜，标准目镜接口；
8.1.3 视向角 6°，视场角 ≥90°；
8.1.4 鲁尔灌流接口；
8.1.5≤4.5MM 橄榄型器械通道，带阀门开关；
8.1.6 具备双路灌流系统；
8.1.7 具备双路照明系统；
8.1.8 可高温高压，低温等离子消毒。
8.2 操作鞘
8.2.1 可 360° 旋转；
8.2.2 配套专用无损伤钝头闭孔器；
8.2.3 直径≤24FR；
8.2.4 鲁尔接口；
8.2.5 操作鞘表面带厘米刻度术；
8.2.6 可高温高压消毒。
8.3. 闭孔器
8.3.1 闭孔器，用于操作鞘配套使用。
8.4 动力刨削手柄
8.4.1 ≥3 种个性化设置握持方式；
8.4.2 中央直排吸引通道；



8.4.3 具有往复切割模式；
8.4.4 切割速率 ≥ 5000 次/分；
8.4.5 具有便捷锁扣，可 360° 安装；
8.4.6 可高温高压消毒。
8.5 刨削刀头
8.5.1 钝性无创头端；
8.5.2 卵圆形、长方形两款开口各 1 套，往复切割工作；
8.5.3 直径 ≤ 4 mm，长度 ≥ 32 cm；
8.5.4 切割方向可 360° 旋转；
8.5.5 配备定位器，与切割窗口方向一致；
8.5.6 含内、外切割刀管，可拆卸，360° 安装；
8.5.7 可重复使用，高温高压消毒灭菌。
8.6 刨削动力主机系统
8.6.1 自动识别器械，即插即用；
8.6.2 可手动设置最高限速；
8.6.3 液晶屏同时显示最高转速与实际转速；
8.6.4 脚踏控制，无级变速；
★8.6.5 最高转速 ≥ 40000 转/分；
8.6.6 兼容妇科动力产品 ≥ 3 种；
8.6.7 可与至少 1 款冲洗吸引泵产品实现双机联动；
8.6.8 防水面板可擦拭消毒；
8.6.9 兼容一体化手术室。
8.7. 冲洗吸引系统
8.7.1 最高流速 ≥ 1000 mL/min；
8.7.2 具有手动、自动两种模式；
8.7.3 可与妇科动力主机实现双机联动；
8.7.4 可用于宫腔镜下吸引，腹腔镜下冲洗或吸引；
8.7.5 配备冲洗管路及吸引管路，可高温高压消毒；



8.7.6 触摸屏，防水面板可擦拭消毒；
8.7.7 兼容一体化手术室。
8.8. 冲洗吸引管
8.8.1 冲洗吸引管：可重复使用冲洗吸引管。
8.9 刨削系统手术器械
8.9.1 持针器，直径 $\leq 3\text{ mm}$ ，工作长度 $\geq 35\text{ cm}$ ；
8.9.2 剪刀尖头，直径 $\leq 3\text{ mm}$ ，工作长度 $\geq 35\text{ cm}$ ；
8.9.3 剪刀，直径 $\leq 3\text{ mm}$ ，工作长度 $\geq 35\text{ cm}$ ；
8.9.4 抓钳，鳄鱼钳口，直径 $\leq 3\text{ mm}$ ，工作长度 $\geq 35\text{ cm}$ ；
8.9.5 活检钳，直径 $\leq 3\text{ mm}$ ，工作长度 $\geq 35\text{ cm}$ ；
8.9.6 配刨削系统专用消毒盒。
9. 电外科能量平台系统
9.1 ≥ 9 吋高分辨率液晶触屏显示器；
★9.2 单极插口： ≥ 2 个；双极插口： ≥ 2 个；
9.3 输出频率：320 kHz -380 KHz；
9.4 设备出现错误时有声音及图像报警提示；
9.5 单极最大输出功率：400W（200 Ω ）；双极最大输出功率：400W（75 Ω ）；
9.6 可以集成到一体化手术室中；
9.7 图形化的操作符号图标；
9.8 每种模式可预设优选参数，在此基础上可以进行个性化调节；
9.9 可将个性化设置的参数设置保存；
9.10 可通过脚踏开关进行两个参数间切换；
9.11 可通过脚踏开关进行两个插口间激活的切换；
9.12 主机编码系统可实现自动器械识别，并自动推荐优选参数；
9.13 对于电切镜、双极电凝、腹腔镜、开放手术、胃内镜手术等设有专用模式；
9.14 单双极模式数量 ≥ 35 个；
9.15 具备设备定期自检功能；
9.16 具有中性电极监测功能；

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



9.17 带有预设程序，同时可以自行设计程序，可存储≥300 个。
10. 腹腔镜台车
10.1 配腹腔镜专用台车。
11. 图文工作站
11.1 配宫腹腔镜图文工作站一套，品牌商用机，高清视频采集卡支持 DVI、HDMI、HD-SDI 等高清信号的接收及存储，彩色打印机，医用专用台车。

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



第五部分 评标办法



1. 评标委员会

1.1 招标机构将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关规定组建评标委员会。

1.2 评标委员会由招标人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标方提交书面评标报告。

1.4 评标方法：综合评分法。

1.5 投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为投标文件的组成部分。

2. 投标文件的初审（资格审查及符合性检查）

2.1 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十三条、《中华人民共和国财政部令第87号》第四十四条，由采购人或采购人委托的采购代理机构对供应商的资格进行审查。评标委员会将审查投标文件是否完整。

2.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

2.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标方可以接受，但这种接受将影响投标人的综合得分。

2.4 在详细评标之前，评标委员会要审查投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和技术参数相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.5 评标委员会不接受有选择的报价。

2.6 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。

3. 投标文件的详细评审



3.1 评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细评审。

3.2 详细评审即以招标文件为依据,对所有实质上响应的投标分别从“技术”“价格”“商务”及“服务”等方面进行评审并按照百分制进行综合打分。

4. 落实政府采购政策

4.1 中小企业政府采购政策

4.1.1 本项目执行财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号，对符合政府采购关于中小企业扶持政策的小微企业投标人的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.1.2 本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立、依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。划分标准见工业和信息化部 统计局 发展改革委 财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

4.1.3 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受前款办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。



4.1.4 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

4.1.5 投标人需根据财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和工业和信息化部 统计局 发展改革委 财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）对照自身情况及所提供产品的制造商、服务商的信息自行判断是否全部属于中小微企业。出具《中小企业声明函》（见投标文件格式）的小微企业，享受小微企业扶持，否则不享受相关中小企业扶持政策。投标人提供的《中小企业声明函》在公示中标结果时公开。

4.1.6 投标人应对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

4.2 监狱企业政策

4.2.1 符合财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的监狱和戒毒企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱、戒毒企业的证明的，视同小型、微型企业享受 10%的价格扣除，监狱、戒毒企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格优惠政策。

4.2.2 投标人为监狱企业且所投货物全部由监狱企业制造的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，未提供或出具证明文件的单位不符合要求的，不视为小型微型企业。

4.3 残疾人福利性单位政策

4.3.1 符合财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）并提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的投标人，视同小型、微型企业享受 10%的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受价格优惠政策。

4.3.2 投标人为残疾人福利性单位且所投货物全部由残疾人福利性单位制造



的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未提供的不视为小型、微型企业。

4.4 节能环保标志产品政策

4.4.1 执行财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、财政部 发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购品目清单〉的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）等政府采购政策，对获得符合政府采购政策的产品实施政府优先采购或强制采购。

4.4.2 投标人可以提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。采购代理机构通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）对获证产品信息进行核对。

4.4.3 投标人所投产品属于下列情形之一的，本应属于优先采购的，不再享受优先采购政策；属于强制采购的，则按无效投标文件处理：

- （1）未提供认证证书扫描件或经核对认证证书存在信息有误的；
- （2）认证证书已过期。

4.4.4 享受中小企业政府采购扶持政策的投标人，可以同时享受节能产品、环境标志产品优先采购政策。

4.4.5 鼓励中标（成交）供应商在提供**货物（产品）**包装、运输按照 财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室《关于印发〈商品包装政府采购需求标准〉（试行）、〈快递包装政府采购需求标准〉（试行）的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的环保要求进行包装。

5. 对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整。若该项目是专门面向中小企业采购的，则不享受价格扣除。

5.1 符合（财库〔2020〕46号）、（财库〔2022〕19号）文件规定的小微企业单位的评标价计算规则：

5.1.1 对符合规定的小型 and 微型企业（非联合体投标）报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）



5.1.2 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-4%）

5.1.3 确认为小微企业（含小型、微型企业，下同）投标的，应当同时符合以下条件：

5.1.3.1 符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）；

5.1.3.2 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.3.3 投标时须提供《中小企业声明函》；

5.2 符合（财库〔2017〕141 号）文件规定的残疾人福利性单位的评标价计算规则：

5.2.1 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

5.2.2 对于联合协议或者分包意向协议约定残疾人福利性单位的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-4%）

5.2.3 确认为残疾人福利性单位投标的，应当同时符合以下条件：

5.2.3.1 符合（财库〔2017〕141 号）文件相关规定。

5.2.3.2 投标时提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

5.2.3.3 投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3 符合（财库〔2014〕68 号）文件规定的监狱企业的评标价计算规则：



5.3.1 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

5.3.2 对于联合协议或者分包意向协议约定监狱企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-4%）

5.3.3 确认为监狱企业投标的，应当同时符合以下条件：

5.3.3.1 符合（财库〔2014〕68 号）文件相关规定。

5.3.3.2 投标时提供本单位生产的货物，或者提供其他监狱企业生产的货物。

5.3.3.3 投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4 符合（财库〔2021〕19 号）文件规定的来自贫困地区提供农副产品的评标价计算规则：

5.4.1 在政府采购活动中，对于来自贫困地区提供农副产品的投标人，报价给予 5% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-5%）

5.4.2 确认为来自贫困地区提供农副产品的投标人，应当同时符合以下条件：

5.4.2.1 符合（财库〔2021〕19 号）文件相关规定，在 832 个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

5.4.2.2 投标时提供本单位生产的货物，或者提供其他贫困地区生产的货物。

5.4.2.3 投标人须提供相关证明文件。

5.5 符合节能产品文件规定的评标价计算规则：

5.5.1 投标货物涉及提供的所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清



单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。

5.6 符合环境标志产品文件规定的评标价计算规则：

5.6.1 投标货物涉及提供的所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。

6. 中标人的确定

6.1 评标委员会根据评标办法的规定对投标人进行评审排序，推荐综合得分最高的前三名为中标候选人，如果两个投标人得分相同时，取投标价格低者。形成评标报告，评审报告由评标委员会全体成员签字确认。

6.2 招标代理机构应在评标结束后 2 个工作日内，将评标报告送达采购人定标。

6.3 采购人在收到评标报告后 5 个工作日内，根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序，确定排名第一的为中标人，也可以书面授权评标委员会评标后直接确定中标人，同时复函采购代理机构。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；如果投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标因素	权 值%	评价要素
价格	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值%×100 符合政策性优惠的，按照招标文件中第五部分，第 5 条执行。



投标产品技术指标及功能评审内容	30	依据各投标人响应的投标产品参数要求等情况进行评审：满足全部参数要求的计 30 分；标注“★”项为关键参数，每一项负偏离扣 5 分，其他每一项负偏离扣 2 分，扣完为止。 备注：提供佐证材料（包括但不限于产品技术说明书、国家认可的第三方检测报告、产品官方网站截图等相关证明材料），并标注页码。若不提供材料或提供虚假参数及材料应标的，按负偏离处理。
产品选型	6	针对本项目所投设备选型合理、功能齐全，规格、型号，配套设施完整，技术资料齐全，并附有详细的配件清单，①配置齐全；②完全满足采购需求；③提供产品备品备件价目表，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用。 每项满分 2 分，缺项不得分，每有一项内容存在缺陷，扣 0.5-1.5 分。
质量保证	4	投标产品货源渠道正规（不限于授权书等）；符合国家的标准和有关规定，有完备可靠的质量保证措施；提供完整的资料证明文件（如产品彩页、技术白皮书、国家认可的第三方检验报告、产品技术说明书等），得 4 分。 有质量保证措施，经过有关部门检测。能保证使用单位正常使用和维护。提供部分资料证明文件，得 2 分。 能保证使用单位正常使用和维护。提供部分资料证明文件，得 1 分。 未提供相关资料证明文件得 0 分。
履约能力	4	拟投入本项目的技术人员配备，内容包括：①人员配备；②职责分工；③相关人员资质证书；④提供相关人员近半年本单位社保缴纳证明等。 人员配备全面合理，责任制度明确符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施。

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



		每项满分 1 分，缺项不得分，每项内容存在缺陷，扣 0.5 分。
供货方案	10	提供详细具体的供货方案，内容包括：①备货、供货进度；②产品安装调试；③验收组织；④工作保障措施；⑤包装运输等。 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施。 每项满分 2 分，缺项不得分，每项内容存在缺陷，扣 0.5-1.5 分。
应急方案	4	提供针对本项目的应急方案，内容包括：①预防机制；②突发事件；③应急响应；④后期处置等。 方案各项内容全面详细、阐述条理清晰、针对性强，实施性科学合理。 每项满分 1 分，缺项不得分，每有一项内容存在缺陷，扣 0.5 分。
售后及培训方案	10	售后服务方案（6 分） 内容包括：①售后服务体系；②人员配置；③服务内容；④项目交付采购人后出现故障的响应时间、解决故障时间；⑤补救措施；⑥定期巡检维护方案等。 售后服务方案各项内容全面详细、阐述条理清晰、针对性、可实施性强，能够向采购人提供专业的售后服务。 每项满分 1 分，缺项不得分，每有一项内容存在缺陷，扣 0.5 分。 培训方案（4 分） 内容包括：①培训人数；②培训时间；③培训内容；④培训方式等。 培训方案各项内容全面详细、阐述条理清晰、针对性、可实施性强，能够向采购人提供专业的培训服务。

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



		每项满分 1 分，缺项不得分，每有一项内容存在缺陷，扣 0.5 分。
业绩	2	提供所投产品（全数字 4K 荧光影像平台系统）2022 年 1 月 1 日至今同类项目的业绩，投标文件中附有其业绩证明材料，业绩以完整合同复印件为依据，每提供一个计 1 分，满分 2 分。
备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。		

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



第六部分 投标文件格式

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



安康市人民医院宫腹腔镜手术系统
采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312

投 标 文 件

投 标 单 位：_____

采购代理机构：_____

时 间：_____



目 录

- (一) 投标函（格式）；
- (二) 投标报价表（格式）；
- (三) 投标报价明细表；
- (四) 商务条款偏离表（格式）；
- (五) 技术规格偏离表（格式）；
- (六) 技术说明文件；
- (七) 法定代表人证明书或授权书（格式）；
- (八) 资格证明文件；
- (九) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
- (十) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明（格式）；
- (十一) 企业关联关系承诺书（格式）；
- (十二) 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）；
- (十三) 中小企业声明函（格式）（如有）；
- (十四) 残疾人福利性单位声明函（格式）（如有）；
- (十五) 监狱企业证明文件（格式）（如有）；
- (十六) “节能产品”“环境标志产品”证明材料（格式）（如有）；
- (十七) 投标方案；
- (十八) 优惠、培训、售后服务承诺（格式）；
- (十九) 项目业绩表（格式）；
- (二十) 其他证明材料。



一、投标函

投 标 函

致：陕西德信招标有限公司

我方确认收到贵方提供（项目编号） （项目名称） 招标文件的全部内容，我方：（投标人名称） 作为投标者正式授权（授权代表全名、职务） 代表我方进行有关本投标的一切事宜。

提交电子投标文件（扩展名为“.SXSTF”），包括如下内容：

- （一）投标报价表；
- （二）投标报价明细表；
- （三）商务条款偏离表；
- （四）技术规格偏离表；
- （五）技术说明文件；
- （六）法定代表人证明书或授权书；
- （七）资格证明文件；
- （八）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
- （九）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；
- （十）企业关联关系承诺书；
- （十一）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书；
- （十二）中小企业声明函（如有）；
- （十三）残疾人福利性单位声明函（如有）；
- （十四）监狱企业证明文件（如有）；
- （十五）“节能产品”“环境标志产品”证明材料（如有）；
- （十六）投标方案；
- （十七）优惠、培训、售后服务承诺；
- （十八）项目业绩表；
- （十九）其他证明材料。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点。

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



- (一) 我方决定参加：_____（项目编号）_____（项目名称）的投标。
- (二) 全部货物及有关服务的投标总价为：_____（大、小写）_____。
- (三) 本投标文件的有效期在投标截止日后____天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。
- (四) 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
- (五) 我方明白不得在规定的开标时间和日期之后、投标有效期之内撤回投标。
- (六) 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其他数据或信息。
- (七) 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。
- (八) 我方如果中标，将保证履行招标文件及其补充文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。
- (九) 如我方中标，我方将在收到中标通知书之前，参照国家计委〔2002〕1980 号、发改委〔2003〕857 号文件规定标准向陕西德信招标有限公司交纳中标服务费。
- (十) 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

投标人名称（加盖公章）：_____

联系地址：_____

投标人授权代表职务：_____

投标人授权代表签字：_____

联系电话：_____

电子邮件：_____

传 真：_____

日 期：_____

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



二、投标报价表

项目名称： _____
项目编号： _____

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单价（元）	投标总价（元）	制造商名称	交货期	质保期	备注
合计	(大写)： _____ (小写)： _____									

投标人（盖章）： _____
法定代表人签字或签章： _____
日期： _____年____月____日

注：投标报价应包括货物费用、随机备品备件、验收、运输费用（货物到最终用户的运费）、安装调试费用、人员培训及投标等全部费用。

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



三、投标报价明细表

（自行编制格式）

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



四、商务条款偏离表

（说明）供应商应根据其提供的服务，对照招标文件合同专用条款要求逐条响应，商务条款不可负偏离，否则视为无效投标。

项目名称：_____ 项目编号：_____

序号	招标文件要求	投标文件内容	偏离	备注

注：请对招标文件商务要求内容逐条响应。

投标人（公章）：_____

授权代表（签名或盖章）：_____

日期：_____

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



五、技术规格偏离表

（说明）技术偏离表不得完全复制粘贴招标文件技术参数要求，否则视为无效
投标。技术偏离表响应内容须提供相关技术支持资料，不提供按负偏离处理。

项目名称：_____ 项目编号：_____

序号	招标文件技术要求	投标文件技术条款	偏离	备注

注：1. 请对招标文件采购内容及要求内容逐条响应。
2. 行数不够，可自行添加。偏离情况写：正偏离、无偏离、负偏离。

投标人（公章）：_____
授权代表（签名或盖章）：_____
日期：_____

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



六、技术说明文件；

（提供所投产品技术支持资料，内容格式自拟）

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



七、法定代表人证明书或授权书

(一) 法定代表人证明书格式（投标人为法定代表人时须出具）

致：陕西德信招标有限公司				
企业法人	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	网址			
	统一社会信用代码			
法定代表人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	传真			
法定代表人 身份证 复印件	二代身份证正、反两面都需复印 (粘贴处)		(法定代表人签字)	
			(企业公章) 年 月 日	

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



(二) 法定代表人授权书格式（投标人为授权代表人时须出具）

致：陕西德信招标有限公司

本授权书声明：注册于_____（国家或地区）的_____

（投标人名称）的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就陕西德信招标有限公司（项目名称、项目编号为_____）招标文件的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书____年____月____日至____年____月____日签字生效，特此声明。

投标人名称：（公章）

地址：

法定代表人：（签名或盖章）

职务：

被授权人：（签名或盖章）

职务：

法人代表与被授权人身份证（复印件）需附在投标文件中。



八、资格证明文件

1. 具有独立承担民事责任能力的法人或非法人组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照等证明文件；
2. 投标人为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证（进口产品除外）；投标人为代理商的根据所投产品类别还需提供第二类医疗器械备案凭证或第三类医疗器械经营许可证；根据所投产品的类别出具该类产品注册证；
3. 所投产品为进口产品时提供完整有效的授权链；
4. 提供经会计师事务所审计的 2023 年财务审计报告或投标截止日前半年内任意一个月的财务报表（至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表）或银行出具的资信证明；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；
5. 提供投标截止日前半年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，成立不足一年的公司提供自成立后至今连续缴存社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；
6. 提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明，单据应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；依法免税的单位应提供相关证明材料；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；
7. 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询结果为准；
8. 本项目不接受联合体投标。

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



九、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(格式自拟)

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



十、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明

无重大违法记录声明

陕西德信招标有限公司：

我_____（投标人名称）以下简称“我公司”参加_____（项目编号）_____（项目名称）的投标，本公司郑重声明，我公司参加本项目招标活动前____年内_____（如实填写有或无）重大违法记录，符合法律法规的有关规定，我公司对此声明负全部法律责任。

特此声明！

投标人名称：_____（公章）

_____年__月__日

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



十一、企业关联关系承诺书

供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

致：陕西德信招标有限公司

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：_____

与我方存在直接控股、管理关系的单位名称如下：_____

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称：_____（公章）

_____年___月___日

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



十二、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1. 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2. 不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3. 不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4. 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6. 不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7. 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称：

公章：

授权代表签字：



十三、中小企业声明函（如有）

请各位投标商根据实际情况提供，没有则不提供。投标人声明函将随结果公告一同公布，接受社会监督。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 填写前请认真阅读《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



十四、残疾人福利性单位声明函（如有）

根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



十五、监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日 期：

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



十六、“节能产品”“环境标志产品”证明材料（如有）

供应商提供的产品属于下列情形的，提供产品列入“节能产品”“环境标志产品”证明材料（如有）所在页的复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效期截止日期等内容），并加盖供应商单位公章。

1、符合政府采购强制采购政策的财政部、环境保护部发布的《节能产品政府采购清单》中标记的“强制采购节能产品”。

2、符合政府采购强制采购政策的财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中标记的“环境标志产品”。

注：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



十七、投标方案

（根据评审因素，内容格式自拟）

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



十八、优惠、培训、售后服务承诺

18.1 优惠条件承诺书

致：陕西德信招标有限公司

经仔细阅读你们的招标文件，我们同意招标文件中有关优惠条件的要求，对所投标项目向贵单位特做如下优惠条件承诺：

(1) ...

(2) ...

(3) ...

...

特此承诺！

承诺方授权代表签字：_____

职 务：_____

承诺方名称：_____

承诺方印章：_____

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

日期： 年 月 日

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



18.2 培训计划承诺

（根据评审因素内容中：售后及培训方案中“培训方案”进行编制）

致：陕西德信招标有限公司

经仔细阅读你们的招标文件，我们同意招标文件中有关培训计划的要求，对所投标项目向贵单位特做如下培训计划承诺：

(1) ...

(2) ...

(3) ...

...

特此承诺！

承诺方授权代表签字：_____

职 务：_____

承诺方名称：_____

承诺方印章：_____

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

日期： 年 月 日



18.3 售后服务

（根据评审因素内容中：售后及培训方案中“售后服务方案”进行编制）

致：陕西德信招标有限公司

经仔细阅读你们的招标文件，我们同意招标文件中有关售后服务方案的要求，对所投标项目向贵单位特作如下售后服务方案：

(1) ...

(2) ...

(3) ...

...

特此承诺！

授权代表签字：_____

职 务：_____

承诺方名称：_____

承诺方印章：_____

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

日期： 年 月 日

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目
项目编号：DXZB-2025-0312



十九、项目业绩表

提供所投产品（全数字 4K 荧光影像平台系统）2022 年 1 月 1 日至今同类项目业绩

序号	项目名称	项目地址及电话	合同内容	签订日期

注：须提供业绩相应的证明材料（如采购合同）。

项目名称：安康市人民医院宫腹腔镜手术系统采购项目

项目编号：DXZB-2025-0312



二十、其他证明材料

（供应商概况等，内容格式自拟）