

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪 一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101

公开招标文件

采购单位：白河县人民医院

代理机构：陕西德信招标有限公司

2025年2月

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



目 录

第一部分	招标公告	1
第二部分	投标人须知及前附表	7
第三部分	商务部分（合同条款及合同格式）	33
第四部分	用户需求书（采购内容及要求）	47
第五部分	评标办法	61
第六部分	投标文件格式	72

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



第一部分 招标公告

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目 招标公告

项目概况

彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取采购文件，并于 2025 年 03 月 07 日 14 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：DXZB-2025-0101

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：3000000.00 元

采购需求：

合同包 1（白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目）：

合同包预算金额：3000000.00 元

合同包最高限价：3000000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	医用超声波仪器及设备	彩色多普勒超声诊断仪	2 台	详见采购文件	3000000.00	3000000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：具体履行起止日期可随合同签订时间相应顺延。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3. 本项目的特定资格要求：

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



合同包 1(白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目)特定资格要求如下：

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人或非法人组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照等证明文件；

(2) 提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证（投标人为法定代表人时，须提交法定代表人证明书）；

(3) 投标人为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证（进口产品除外）；投标人为代理商的根据所投产品类别还需提供第二类医疗器械备案凭证或第三类医疗器械经营许可证；根据所投产品的类别出具该类产品注册证；

(4) 提供经会计师事务所审计的 2023 年财务审计报告或投标截止日前半年内任意一个月的财务报表（至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表）或银行出具的资信证明；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；

(5) 提供投标截止日前半年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，成立不足一年的公司提供自成立后至今连续缴存社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；

(6) 提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明，单据应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；依法免税的单位应提供相关证明材料；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；

(7) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(8) 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

(9) 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准；

(10) 本项目不接受联合体投标。

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



三、获取采购文件

时间：2025年02月14日至2025年02月20日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2025年03月07日14时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

五、开启

时间：2025年03月07日14时00分00秒（北京时间）

地点：本项目采用电子化和远程不见面开标（投标单位远程开标，无需到场），“不见面开标大厅”登录网址 <http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1. 在报名规定时间内使用捆绑省交易平台的CA锁登录安康市公共资源交易中心（<http://ak.sxggzyjy.cn/>），选择电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。

2. 本项目采用电子化与远程开标方式，投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标前，供应商需登录不见面开标大厅（网址：

<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>）。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法解密投标文件，按无效投标对待，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南一下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000



3. 各供应商须在招标文件获取时限内（即报名期内）登录全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）系统，直接下载扩展名为（*.SXSZF）的电子版招标文件，未下载文件的供应商将无法提交电子投标文件；在报名时间截止后获取招标文件的供应商视同为无效；

4. 请各投标人购买招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

5. 采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（2）财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（4）财政部 发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购品目清单〉的通知》（财库〔2019〕19号）；

（5）财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

（6）财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（7）财政部 农业农村部 国家乡村振兴局《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（8）国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（9）陕西省财政厅《关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、陕西省财政厅 中国人民银行西安分行《关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）；

（10）陕西省财政厅《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



财办采（2021）29号）；

（11）陕西省财政厅《关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》
（陕财办采（2023）4号）。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：白河县人民医院

地址：白河县城关镇书院北路18号

联系方式：0915-7822258

2. 采购代理机构信息

名称：陕西德信招标有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区南二环东段凯森盛世B座四层

联系方式：029-82694900 转 9021

3. 项目联系方式

项目联系人：李敏、周菊

电话：029-82694900 转 9021、9022

陕西德信招标有限公司

2025年02月13日

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



第二部分 投标人须知及前附表

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



一、投标人须知前附表

本表关于招标货物及有关服务的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

序号	内 容
1.	买方名称：白河县人民医院 买方地址：白河县城关镇书院北路 18 号 联系人：吴老师 联系方式：0915-7822258
2.	招标代理机构：陕西德信招标有限公司 地 址：陕西省西安市雁塔区南二环东段凯森盛世 B 座四层 联系人：李敏、周菊 联系电话：029-82694900 转 9021、9022
3.	采购内容：彩色多普勒超声诊断仪 采购数量：2 台 采购预算：人民币 3000000.00 元
4.	项目所属行业：工业
5.	该项目非专门面向中小企业采购
6.	政府采购信息发布媒体（采购公告、采购结果公告、变更公告） (1) 陕西省政府采购网：仅提供项目公告，官网地址： http://ccgp-shaanxi.gov.cn/ (2) 全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）：即安康市公共资源交易平台，提供项目公告和采购文件下载。官网地址： http://ak.sxggzyjy.cn/
7.	投标有效期：90 天
8.	投标语言：中文
9.	投标报价：人民币报价，最终目的地价。
10.	评标方法：综合评分法，不保证最低价中标。

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



11.	中标服务费账户： 开户名称：陕西德信招标有限公司 开户银行：西安银行东二环南段支行 账 号：209011580000073440
12.	投标截止时间：2025年03月07日14时00分00秒（北京时间）。 投标文件递交地点：安康市公共资源交易中心电子交易平台。
13.	开标时间：2025年03月07日14时00分00秒（北京时间）。 开标地点：本项目采用电子化和远程不见面开标（投标单位远程开标，无需到场）， “不见面开标大厅”登录网址 http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/logi
14.	<p>（1）本项目采用电子化投标方式（不见面开标系统）</p> <p>投标人须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必带数字认证证书，如因投标单位自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。</p> <p>（2）制作电子投标文件</p> <p>投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）http://www.sxggzyjy.cn/的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。”</p> <p>（3）递交电子投标文件</p> <p>登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台 — 陕西政府采购交易系统 — 企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务 — 我的项目 — 项目流程 — 上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。</p> <p>（4）开标签到</p> <p>投标单位等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后将无法签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前30分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。</p> <p>（5）注意事项</p> <p>①为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用IE11浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省</p>

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



	<p>公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为： https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）。</p> <p>②建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 30 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。</p> <p>③及时关注右侧公告及互动栏目信息。</p>
15.	<p>投标文件的提交：</p> <p>在《安康市公共资源交易中心》投标截止日前上传加密的电子投标文件（扩展名为“.SXSTF”）。</p> <p>项目开标结束后，所有供应商须提供正本的 Word 版本及加盖公章 PDF 版本电子投标文件发送至 410690238@qq.com。中标供应商在领取中标通知书时提供一正二副纸质投标文件用于备案。</p>
16.	<p>(1) 技术偏离表不得完全复制粘贴招标文件技术参数要求，否则视为无效投标。</p> <p>(2) 技术偏离表响应内容须提供相关技术支持资料；技所提供的资料须清晰反应关键内容，未按要求提供的视为无效资料，不予认可。</p> <p>(3) 所提供的支持资料应图文清晰、易于辨识，否则由此带来的不利后果由投标人自行承担。</p> <p>(4) 投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。</p> <p>说明：相关技术支持资料包括产品技术说明书、国家认可的第三方检测报告、产品官方网站截图、技术白皮书等。如不提供，引起的一切后果，投标人自行承担。</p>
17.	<p>落实的政府采购政策：</p> <p>(1) 对小型或微型企业参加政府采购投标的扶持：</p> <p>根据财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46 号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；供应商可在投标文件中提供小型和微型企业声明；</p> <p>(2) 对监狱企业、残疾人福利企业的扶持：</p> <p>根据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）</p>



	<p>出具的属于监狱企业的证明文件)、财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定,对监狱企业、残疾人福利企业给予 10%的价格扣除,用扣除后的价格参与评审;</p> <p>对同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的,不重复享受政策。</p> <p>(3) 对节能、环保政策的支持</p> <p>①根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和财政部 发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购品目清单〉的通知》(财库〔2019〕19号)的规定,若投标货物属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品,供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p> <p>②根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)的规定,若投标货物属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品,供应商提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。</p> <p>③产品同时属于“非强制采购节能产品”、环境标志产品的,评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择,并在报价文件中填写相关信息及数据)。</p>
<p>18.</p>	<p>强制认证产品说明:</p> <p>所投产品属于国家强制认证产品的应获得强制认证且证书在有效期内,否则不得投标。不论查验与否,提供本应获得而未获得 CCC 认证产品的投标和中标(成交)将被取消。</p>
<p>19.</p>	<p>为支持和促进中小企业发展,进一步发挥政府采购政策功能作用,有效缓解中小企业融资难等问题,根据财政部《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》(财库〔2011〕124号)文件的精神,陕西省财政厅制订了《陕西省政府采购信用担保试点工作实施方案(试行)》和陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)、陕西省财政厅《关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》(陕财办采〔2018〕23号)、陕西省财政厅 中国人民银行西安分行《关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》(陕财办采〔2023〕5号)文件,为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保,并按照程</p>

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



	<p>序确定了合作的担保机构。中标（成交）供应商如果需要融资贷款服务的，可凭中标（成交）通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理。具体规定可登录陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）重要通知专栏中查询了解</p>
20.	<p>法律、行政法规规定的其他条件：</p> <p>（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；</p> <p>（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；</p>
21.	<p>供应商注册登记提醒：</p> <p>根据“陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知”，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。</p>
22.	<p>供应商信用信息查询说明：</p> <p>采购人、采购代理机构在供应商递交投标文件或响应文件时，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），查询供应商信用是否合格并记录，将查询网页、内容截图或拍照，留档保存。此查询信息仅作为本项目使用。</p>
23.	<p>供应商如放弃本项目投标，应在递交投标（响应）文件截止时间前一日以电子邮件形式发送至 410690238@qq.com 告知采购代理机构，否则采购代理机构可向财政部门反映情况并提供相应佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。</p>
24.	<p>依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第四十三条，招标过程中经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有 2 家时，经采购人书面请示政府采购管理机构同意后，现场转变采购方式为竞争性谈判，评审办法按照《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）规定执行。</p>



二、投标人须知

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

2. 名词解释

2.1 采购人：白河县人民医院

2.2 采购代理机构：陕西德信招标有限公司

2.3 监督管理机构：白河县财政局

2.4 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5 投标人代表：是指参加投标竞争中代表投标人的法定代表人或者是其被授权人，投标人代表是唯一的。

3. 特殊情形

3.1 特殊情形：指具有独立承担民事责任能力的非法人组织或自然人。

3.2 特殊情形规定

3.2.1 非法人组织：

① 事业单位参加投标的，应参照本招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求法人代表签字处可以是事业单位的法人签章；

② 分公司参加投标的（须提供总公司出具的法人授权），应参照本招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求法人代表签字处可以是分公司的负责人签字；

③ 个体户参加投标的，应参照本招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求法人代表签字处可以是其经营者本人签字；

3.2.2 自然人：自然人投标的，应参照本招标文件给出的投标文件格式制作，其中投标文件要求盖公章处可以是自然人本人的手印；不接受自然人授权他人参加投标。

4. 招标文件

4.1 招标文件的组成

(1) 招标公告

(2) 投标人须知及前附表



- (3) 商务部分（合同条款及合同格式）
- (4) 用户需求书（采购内容及要求）
- (5) 评标办法
- (6) 投标文件格式

4.2 招标文件询问、质疑和投诉

4.2.1 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

根据采购人和采购代理机构签订的《政府采购委托代理协议》，针对采购需求（包括采购内容、技术或服务要求、商务要求、合同条款、供应商资格条件、评审要素及分值一览表）的询问请向采购人、采购代理机构提出。

4.2.2 质疑

(1) 供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

(2) 质疑方式：

以书面形式质疑：

书面质疑函应按照财政部国库司制定的《政府采购供应商质疑函范本》进行填写，签字、盖章后提交至采购人、采购代理机构。

(3) 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖单位公章，公章不得以合同章或其他印章代替。供应商委托代理人提出质疑的，应当同时提交供应商签署的授权委托书。

(4) 在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人、采购代理机构将在收到书面质疑后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

(5) 有下列情形之一的，属于无效质疑：

- ① 对采购文件提出质疑的质疑人不是依法获取采购文件的潜在供应商；对

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



采购过程、中标结果提出质疑的质疑人不是参与本次政府采购项目的供应商；

② 超过法定期限或未以书面形式提出的；

③ 缺乏必要的证明材料，或捏造事实、提供虚假材料，或以非法手段取得证明材料的；

④ 质疑函没有合法有效的签字、盖章或委托授权书的（代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书）；

⑤ 针对同一采购程序环节又提出其他质疑事项的，或质疑答复后就同一事项再次提出质疑的；

⑥ 不符合法律法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

4.2.3 投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）相关规定向本项目同级财政，政府采购监管部门提出投诉。

（2）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。供应商提出投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按财政部《投诉书范本》给定的格式进行填写。

4.2.4 恶意质疑、投诉的法律后果

对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理：

《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实或提供虚假材料或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。

4.2.5 递交联系部门：政府采购部

联系电话：029-82694900

通讯地址：陕西省西安市雁塔区南二环东段凯森盛世 B 座四层



4.3 招标文件的澄清

投标人若对招标文件有疑问，应将要求澄清的问题以书面形式通知招标机构。

4.4 招标文件的补充和修改

4.4.1 招标机构可以用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。

4.4.2 所颁发的补充通知将于投标截止时间前发往所有购买招标文件的投标人。该补充通知作为招标文件的一部分。投标人在收到该通知后须予以签收确认。

4.4.3 考虑到补充通知的影响，委托人和招标机构可决定推迟投标截止时间。

5. 投标和招标总则

5.1 投标文件的编写

5.1.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的“投标文件格式”规定及要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

5.1.2 投标语言和计量单位

投标文件和来往函件用中文书写（外文函件必须翻译为中文），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。（除非招标文件中另有规定）。

5.1.3 投标人应按招标文件规定的投标范围进行投标。

5.1.4 投标报价：投标报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其他相关的一切费用。

5.1.4.1 供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

5.1.4.2 供应商应严格按照《投标文件格式》部分《投标报价表》中的相关要求填写分类报价及其他需要响应的内容。投标报价只能提交唯一报价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

5.1.4.3 投标报价货币：人民币；单位：元。

5.1.4.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下



列规则修正：

A. 投标文件中投标报价表内容与投标文件中其他位置相应内容表述不一致的，以投标报价表为准；

B. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

D. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

E. 因供应商对招标文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

5.1.5 关于进口产品

5.1.5.1 根据财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库〔2007〕119号）规定，政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，应当在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，依法开展政府采购活动。

5.1.5.2 根据财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）有关规定，财政部门审核同意购买进口产品的，投标邀请函将明确载明“允许进口产品参与”，此时满足招标文件要求的国产产品仍然可以参与竞争；否则，视为拒绝进口产品参与，供应商以进口产品参与投标时，将作无效投标处理。

5.1.5.3 优先采购向我国转让技术、提供培训服务、其他补偿贸易措施及与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的产品。

5.2 投标文件的组成

5.2.1 投标人提交的投标文件至少应包括以下部分：

- (1) 投标函；
- (2) 投标报价表；
- (3) 投标报价明细表；
- (4) 商务条款偏离表；



- (5) 技术规格偏离表；
- (6) 技术说明文件；
- (7) 法定代表人证明书或授权书；
- (8) 资格证明文件；
- (9) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
- (10) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；
- (11) 企业关联关系承诺书；
- (12) 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书；
- (13) 项目业绩表；
- (14) 投标方案；
- (15) 优惠、培训、售后服务承诺；

缺以上任一项的投标将被视为无效投标。

5.2.2 投标人可在满足“用户需求书（采购内容及要求）”中对设备的整体要求的前提下，对设备中的软硬件配置提出合理化建议。

5.3 投标

5.3.1 本项目采用电子化和远程不见面开标（投标单位远程开标，无需到场），“不见面开标大厅”登录网址：

<http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login>

5.3.2 项目开标结束后，所有供应商须提供正本的 Word 版本及加盖公章 PDF 版本电子投标文件发送至 383581127@qq.com。中标供应商在领取中标通知书时提供一正二副纸质投标文件用于备案。

5.3.3 纸质版投标文件一式叁份，其中正本壹份，副本贰份。在每一份文件上要注明“正本”或“副本”字样。

5.3.4 投标文件的正本需打印，并由法定代表人或经正式授权的代表在投标文件上签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

5.3.5 投标人名称应当填写全称，同时加盖公章。

5.3.6 纸质版投标文件不得随意涂改和增删，应当跟开标时上传的电子投标

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



文件一致。任何行间如有修改错漏之处，涂改或增删，必须由法定代表人或授权代表在旁边签字、盖章才有效。

5.3.7 投标人应当按照招标文件中提供的统一格式制作投标文件，投标文件中应当有目录。

5.3.8 纸质版投标文件必须工整、规范、统一、清晰，采用 A4 幅面纸胶装成册、标注页码。

5.3.9 若投标人对文件理解有误，产生的后果由投标人自行承担。

5.4 投标的有效期

从投标截止日期起，投标有效期为 90 天。在特殊情况下，招标机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式。

5.5 **合同签订后请将合同复印件一份送至代理机构或将扫描件发至采购代理机构邮箱：410690238@qq.com，以便及时归档。**

5.6 投标文件的修改：

在规定的时间内，投标人可以修改其投标文件的内容，但必须以书面形式通知招标机构。在招标规定的修改截止时间后，投标人不可以修改其投标文件的内容。

5.7 投标的撤回

在投标截止时间前投标人可以撤回其投标，但在投标截止后不允许撤回投标。

5.8 招标过程及评审

5.8.1 招标机构将在招标公告中规定的时间和地点接受投标。

5.8.2 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评审。

5.8.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件将视为无效投标。出现但不限于下列情况之一的，其投标将视为无效投标：

- (1) 投标文件不完整的；
- (2) 投标文件无法人代表签字或签字人未被法人授权的；
- (3) 投标有效期不足的；
- (4) 投标文件附有招标方不能接受条件的；
- (5) 投标总价超出项目预算或明显高于市场价格的；
- (6) 按招标文件要求其他不符合招标方要求的。



5.8.4 评标委员会将按已定的原则及方法进行评审，详见评标办法。

5.8.5 评标委员会在确定中标候选人以前有权按照有关法规拒绝任何或全部投标，对此造成对投标人的影响不负任何责任，不做任何解释。

5.8.6 确定中标人后，由招标机构发出中标通知书，中标人应 25 日内与采购人签约。

5.8.7 招标机构没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

5.9 招标、评标过程的保密性。

5.9.1 接受投标后，直至中标商与买方签订合同后止，凡与招标、审查、澄清、评价、比较、授标意见有关的内容，任何人均不得向投标人及与评审无关的其他人透露。

5.9.2 从投标截止日起到确定中标人止，投标人不得与参加招标、评审的有关人员私下接触。在评审过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面对参与评审的有关人员和买方施加任何影响，其投标将被拒绝。

5.9.3 关于同一品牌产品的处理

5.9.3.1 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

5.9.3.2 非单一产品采购项目，采购人将根据采购项目技术构成、产品价格比重等因素确定核心产品（可能不止一种），并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品有部分采用或全部采用相同品牌的，按一家供应商计算。

5.10 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造；工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业承接（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。否则其投标将被认定为投标无效。

6. 签约及中标服务费



6.1 中标人须向招标机构缴纳足额中标服务费并领取中标通知书。

6.2 中标人须向招标机构按如下标准和规定交纳中标服务费：

(1) 中标服务费币种与中标通知书中标价的币种相同；

(2) 中标服务费不列在投标报价表中；

(3) 招标代理服务费参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定向中标（成交）供应商收取。

6.3 合同签订、履行及验收

招标文件、投标文件、澄清、补充合同等为政府采购合同的组成部分，具有同等法律效力。

6.3.1 签订政府采购合同

6.3.1.1 自中标通知书发出之日起25日内，采购人与中标供应商应按招标文件和中标供应商投标文件的约定，签订书面合同。

6.3.1.2 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照《政府采购法实施条例》第四十九条规定，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

6.3.1.3 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

6.3.1.4 质疑或者投诉事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

6.3.2 合同公告及备案

6.3.2.1 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网对合同进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

6.3.2.2 采购人应自合同签订之日起7个工作日内将政府采购合同报送监管机构备案。



6.3.3 履行合同

6.3.3.1. 合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

6.3.3.2. 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》及合同条款的有关规定进行处理。

6.3.4 验收或考核

6.3.4.1 采购人严格按照国家相关法律法规的要求及招标文件的要求组织验收或考核。

6.3.4.2 采购人按《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）、《保障中小企业款项支付条例》（国务院令 第728号）等规定及采购合同的约定进行支付合同款项。

7. 陕西省中小企业政府采购信用融资办法及说明

陕西省中小企业政府采购信用融资办法

第一条 为进一步贯彻落实国务院和我省关于支持中小企业发展的政策措施，发挥政府采购政策导向作用，充分利用信息化技术，通过搭建信息对称、相互对接的平台，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题。根据《政府采购法》以及《政府采购促进中小企业发展暂行办法》等有关规定，结合本省实际，制定本办法。

第二条 本办法所称“中小企业”包括中型、小型及微型企业，其划型标准按照《工业和信息化部 统计局 发展改革委 财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。

第三条 本办法所称的政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

第四条 开展政府采购信用融资的银行，应当为在陕西省境内注册或设立分支机构，并经财政部门审核且在我省政府采购信息系统搭建服务链接窗口的金融机构。

第五条 政府采购信用融资应当坚持“财政引导，市场运行，银企自愿，互



惠共赢”的原则。

第六条 省财政厅以全省统一的电子化政府采购系统为平台，对接银行信息化系统，推进政府采购中标成交信息、合同信息、融资信息、支付信息和信用信息等信息资源共享。

第七条 各级财政部门应当以政府采购诚信考核和信息化建设为基础，积极为中小企业信用融资搭建平台，提供银企对接的机会和相关的服务支持，但不得为相关贷款项目提供任何形式的担保。

第八条 各银行可自主决定是否提供政府采购信用融资以及融资额度，并与供应商签订融资协议；各供应商也可自行决定是否参加政府采购信用融资，并自愿选择合适的融资银行及在该银行开设银行账户。任何单位和个人不得干预银企双方开展政府采购信用融资业务。

第九条 政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

第十条 银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

第十一条 中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

第十二条 银行应按规定对申请信用融资的供应商的政府采购合同信息进行审查，必要时可通过陕西政府采购网对该政府采购合同进行审核，以确保政府采购合同的真实性和有效性。

第十三条 对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



第十四条 各银行应当建立政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，简化贷款审批程序，制定相应业务管理规范，审核无误后，银行应当凭合同和事先约定的优惠利率及时予以放款，提供快捷、方便、专业的融资服务。

第十五条 省本级政府采购资金支付时，各采购单位必须将采购资金支付到备案合同中指定的融资银行及收款账号，以保障贷款资金的安全回收。

第十六条 各市县操作程序由各地结合本地实际自行拟定，但应当体现“便捷高效、监管有效、风险可控”的原则。

第十七条 供应商弄虚作假或以伪造政府采购合同等方式违规获取政府采购信用融资，或无故不及时还款的，或出现其他违反本办法规定情形的，除按融资合同约定承担违约责任外，同级财政部门应当将其行为按“不良行为”记入供应商诚信档案；情节严重的，应记入供应商“黑名单”；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

第十八条 本办法由陕西省财政厅负责解释。

供应商融资申请操作手册

政府采购合同融资是指在地方财政部门引导下，参与政府采购中标（成交）的供应商可凭政府采购合同向银行申请信用融资，银行按优于一般中小企业贷款利率发放贷款的融资模式。这种融资模式以国库集中支付作为履约保障的政府采购合同为基础，借力政府采购诚信保障，提供了银企对接的机会，缓解了企业融资困境。


政府采购合同融资申请获批的必要条件是，供应商将意向申请银行指定的资金受监管账户签入采购合同，获得银行认可，以保障银行回收贷款路径安全。企业可在签署采购合同前完成意向申请银行开户，并将开户账号签入采购合同作为唯一收款账户；如申请融资时已签署采购合同的，企业应将意向申请银行开户账号通过采购合同变更的方式，将开户账号签入采购合同作为唯一收款账户，无论哪种情况，最终的采购合同都需要获得银行的认可，才能获得银行的正式授信。

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目


项目编号：DXZB-2025-0101



业务流程简图如下：

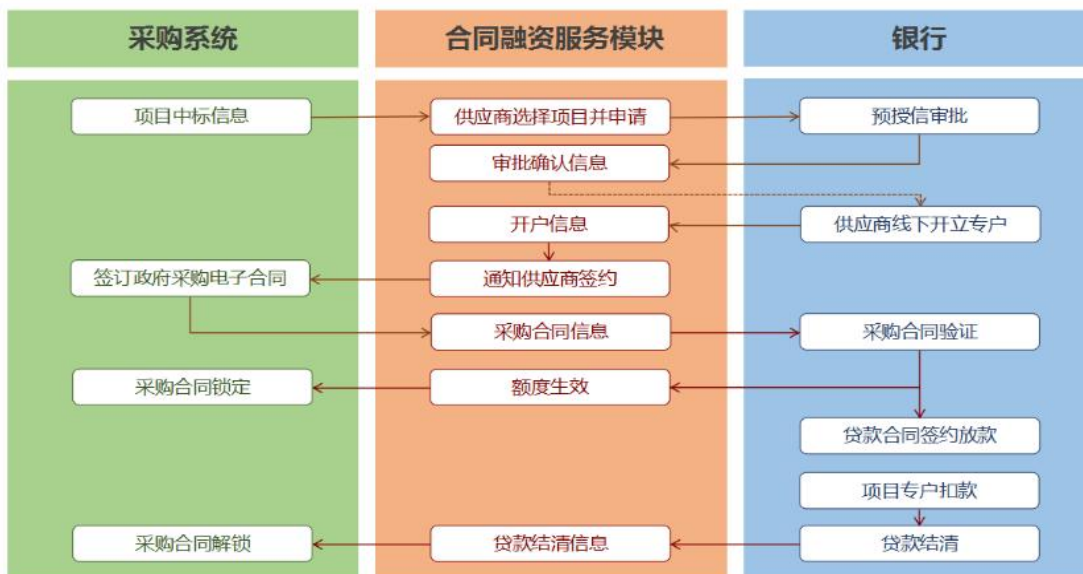


未签订采购合同申请流程

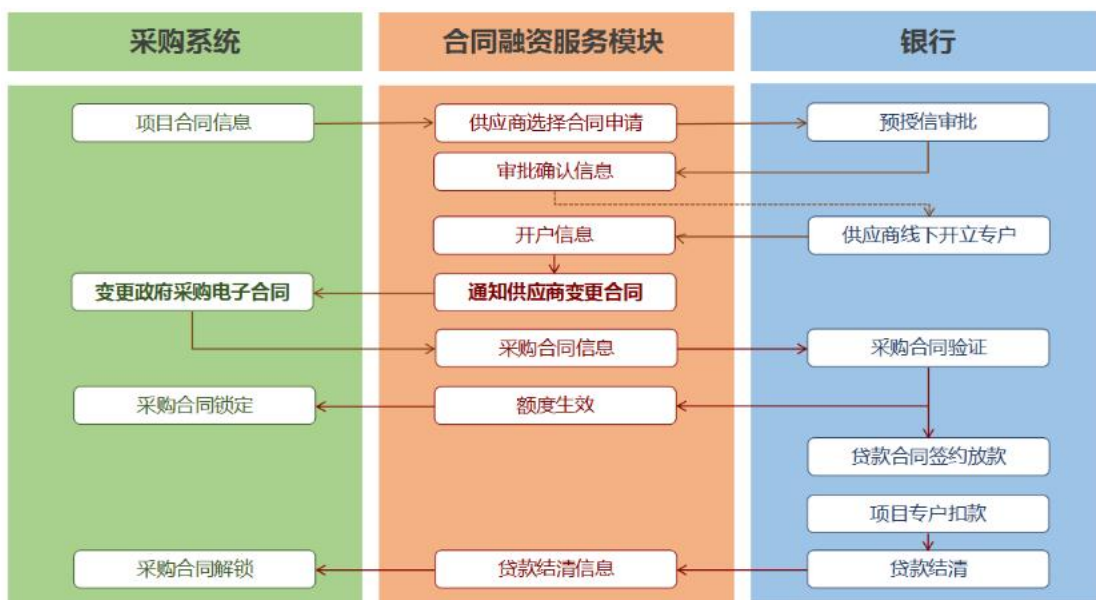

已签订采购合同申请流程

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



陕西省政府采购支持中小企业信用融资合作银行目录（参考）

序号	银行名称	授信额度	贷款期限	贷款利率
1	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	融资申请人为公司的额度不低于 300 万元； 融资申请人为个人的，额度不高于（含）300 万元； 单笔额度不高于订单金额的 70%	最长不超过(12)个月或(360)天	1、不超过中小企业同期市场利率水平 2、利率浮动区间（1 年期 LPR-1 年期 LPR+194bps）
2	中国建设银行陕西省分行	根据单笔政府采购合同金额核定，最高融资金额为合同金额的 90%	最长不超月或（360）天或（12）个月	不超过中小企业同期市场利率水平 2、利率浮动区间（4.5%—5%）
3	中国光大银行股份有限公司西安分行	原则上单户贷款金额最高不超过 1000 万元	最长不超过 12 个月	不超过中小企业同期市场利率水平
4	中信银行股份有限公司西安分行	最高 1000 万元	最长不超过 12 个月	不超过中小企业同期市场利率水平
5	北京银行股份有限公司西安分行	不超过 1000 万元，我行依据中标供应商通过政府公开招标程序中中标并执行的采购合同，通常提供不超过采购资金缺口 70%的额度，对于优质客户可放宽至 80%（采购资金缺口=合同金额-已付/预付货款-质保金）	2 年期综合授信（提前期 1 年，每笔业务期限不超过 1 年）	不超过中小企业同期市场利率水平
6	平安银行股份有限公司西安分行	最高 500 万元	最长不超月或（360）天或（12）个月	利率浮动区间（6%—8%）
7	兴业银行股份有限公司西安分行	不超过 1000 万元（首次申贷客户不超过 500 万元）	最长不超过(12)个月或（/）天	不超过中小企业同期市场利率水平
8	陕西秦农农村商业银行股份有限公司	最高授信额度 1000 万元	原则上不超过 1 年，最长不超过 2 年	不超过中小企业同期市场利率水平

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



9	中国工商银行股份有限公司陕西省分行	经营快贷一政采贷单户不超过500万元且不超过订单金额的90%，线上供应链根据订单和应收贷款合理确定贷款额度。	最长不超过(36)个月或3年	1、按照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率(LPR)确定；2、利率浮动去电(最高不超过LPR+50bp)
10	招商银行股份有限公司西安分行	最高3000万元	非工程类不超过1年，工程类不超过3年	不超过中小企业同期市场利率水平
11	浙商银行股份有限公司西安分行	最高不超过1000万	最长不超过(36)个月	利率浮动区间(依据总行利率指导价执行)
12	中国银行股份有限公司陕西省分行	中标合同金额70%，最高1000万元	最长不超过(24)个月	不超过中小企业同期市场利率水平
13	中国邮政储蓄银行股份有限公司陕西省分行	300万元	最长不超过(12)个月或(360)天	不超过中小企业同期市场利率水平，利率浮动区间为3.85%—5.95%
14	西安银行股份有限公司	300万元	最长不超过(36)个月	不超过中小企业同期市场利率水平
15	中国民生银行股份有限公司西安分行	最高500万元	最长不超过(12)个月	不超过中小企业同期市场利率水平
16	中国农业银行股份有限公司陕西省分行	3000万元以下	最长不超过(12)个月	不超过中小企业同期市场利率水平，利率浮动期间(3.85%—4.35%)
17	浙江网商银行股份有限公司	上限1000万	一年	5%—7%
18	平安银行股份有限公司	上限1000万	一年	5%—9%

注：以上银行合作有效时间及授信额度、贷款期限、贷款利率仅供参考，具体规定可登录陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）重要通知专栏中查询了解。



8. 安康市公共资源交易平台全流程电子化政府采购项目内容

8.1、关于需要特别提醒供应商的内容

8.1.1、本项目采用电子化投标的方式，供应商须使用数字认证证书对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

8.1.2、因投标人（含供应商、投标人、竞买人等）自身问题，电脑遭遇网络堵塞、病毒入侵、硬件故障或者数字证书遗失、遗忘等原因导致不能正常参与电子交易活动的，后果由投标人承担。

8.1.3、制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。

8.1.4、标书雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心 2021 年 7 月 22 日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对供应商的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如 MAC 地址、硬盘序列号、CPU 编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标供应商的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18 号），该情形可以视为投标供应商串通投标，其投标无效。

8.1.5、递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目—项目流程—

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

8.2、关于报名

8.2.1、购买须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；

8.2.2. 确认：请在文件发售时间以内将网上投标成功回执单、单位介绍信、被授权人身份证（复印件加盖公章）在代理机构处进行投标登记，确认完毕后方可下载文件；

8.2.3、未完成网上投标成功的或未经采购代理公司确认或未在规定时间内在平台上下载文件的，无法完成后续流程；

8.2.4、本项目采用电子化投标的方式（落实无纸化交易，无需提供纸质版文件），相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南—下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

8.2.5、电子招标文件技术支持：4009280095、4009980000。

8.3、关于文件的制作和签名

8.3.1、为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子化投标的方式（落实无纸化交易，无需提供纸质版文件）。

8.3.2、编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

8.3.2.1 电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台—企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程—交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）；

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程）答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

8.3.2.2 电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南—下载专区]免

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）》

下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20180827/c8c8fb15-a7cc-4011-a244-806289d7cf3b.html>，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南—下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》，下载网址：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20170821/c3afa05b-f5e6-4e64-9fb0-e397ef73413d.html>；

8.3.2.3 制作电子投标文件

电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000。

8.4、关于响应文件递交与解密

8.4.1. 文件递交

8.4.1.1 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台—企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页）电子交易平台）企业端）我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

8.4.2. 文件开启与解密

8.4.2.1 开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）在开标室的解密机上自行解密电子投标文件。涉及二次报价的，一定携带主锁报价，只有主锁才有签章功能，二次报价才能完成。

8.4.2.2 电子开标失败时，由于投标人（含供应商、投标人、竞买人等）自身问题，电脑遭遇网络堵塞、病毒入侵、硬件故障或者数字证书遗失、遗忘等原因导致不能正常参与电子交易活动的，后果由投标人承担。

8.4.2.3 在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：



- a. 供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
- b. 因供应商自身原因（如未带 CA 锁或所带 CA 锁与制作电子投标文件使用的 CA 锁不一致或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；
- c. 上传的电子投标文件无法打开的；
- d. 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

8.4.2.4 特殊情形下的应急处置

参照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》第五条 出现以下情形的，可延续电子开评标流程：

（一）在开评标过程中出现硬件设备（包括电脑、打印机、投影仪等）故障导致招标代理机构无法使用进行正常开评标的，代理机构应及时与公共资源交易中心工作人员联系，通知交易中心信息技术保障人员迅速判断、检查、排除设备故障，修理或更换有问题的设备。故障在 2 小时内可修复的，可延续电子开标评标流程。

（二）出现电子交易系统和网络异常情况，导致代理机构无法进行正常开评标时，代理机构要及时联系交易中心信息技术保障人员迅速判断、及时排除系统信息故障。首先可尝试使用无线、移动数据等其他应急网络继续开评标。若更换网络或简单维修后，仍无法正常进行的，应联系电子政务办，将电子政务外网转换为内网运行。故障在 2 小时内可修复的，可延续电子开标评标流程。

（三）交易中心出现临时停电断电的紧急情况，代理机构应及时通知交易中心的后勤保障服务人员，迅速查找停电原因，进行修理尽快恢复供电。故障在 2 小时内可修复的，可延续电子开标评标流程。

第六条 2 小时内无法修复的，由代理机构根据招标人意见，可按照以下解决方案进行。

方案一：延续电子开评标流程。经招标人同意后，由代理机构向交易中心出具电子开评标情况说明，并由招标人、代理机构、评审专家等相关人员签字盖章，确定新的开评标时间，待故障排除后再继续完成电子开评标流程。

方案二：另行择期开评标。由招标人征求所有投标人同意，并报监管部门备案后公布。待故障修复后，由招标代理原文发布至统一交易平台，重新确定

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



时间开评标。重新开评标时间自补充通知之日起不少于1个工作日。

第七条 故障修复期间，招标人、代理机构等相关人员要严格做好开评标信息保密工作，同时安排评标专家至休息地点等候，待故障修复后继续在指定地点开标、评标。评标专家有特殊情况确实不能继续参与评标的，予以补抽专家。择期另行开评标的，评标专家需重新抽取。

8.4.2.5 延时情况说明由代理机构将突发情况的原因、经过、解决措施，延时时间等进行详细准确的书面记录，再由招标人和代理机构等相关人员签字确认。

8.4.2.6 采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



第三部分 商务部分（合同条款及合同格式）

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，， 买方有权在签订合同同时对合同的相关条款及内容做进一步的细化和修改。）



商务部分

一、合同专用条款

本表关于招标货物和服务的具体要求是对本合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。

序号	内容
1.	买方（采购人）名称：白河县人民医院
2.	卖方名称：
3.	交货期：自合同签订之日起 30 个工作日内交货。
4.	质保期：整机（含探头）保修≥3 年。
5.	付款方法和条件：合同签订后一个月内支付合同总金额的 40%；设备安装调试培训验收合格后半年内支付合同总金额的 50%；剩余的 10% 使用满一年后一次性支付。
6.	应提供的伴随服务： 选所有
7.	交货地点：白河县人民医院指定地点。

注：以上要求不可负偏离，否则视为无效投标。



二、合同通用条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

- 1) “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
- 2) “合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。
- 3) “货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、硬件设备、软件和其他材料。
- 4) “服务”系指根据本合同规定卖方承担与本项目有关的技术开发及服务。如运输、保险以及其他的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。
- 5) “合同条款”系指本合同条款。
- 6) “买方”系指在合同专用条款中指定的购买货物和服务的单位。
- 7) “卖方”系指在合同专用条款中指定的提供合同项下货物和服务的公司或其他实体。
- 8) “项目现场”系指本合同项下本项目安装、运行的现场，其名称在合同专用条款中指明。
- 9) “天”指日历天数。

2. 适用性

本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3. 标准

3.1 本合同下交付的服务应符合“用户需求书（采购内容及要求）”要求所述的标准。如果没有提及使用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

3.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

4. 使用合同文件和资料

4.1 卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



计划、图纸、模型、样品或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

4.2 除了履行本合同外，卖方不应使用合同条款 4.1 条所列举的任何文件和资料。

4.3 除了合同本身以外，合同条款第 4.1 条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

5. 专利权

卖方应保证，买方使用该货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

6. 服务

卖方（中标人）必须负责系统集成，包括但不限于设计、安装、调试、培训、验收及售后服务。

7. 伴随服务

7.1 卖方可能被要求提供下列货物和服务中的所有服务，包括“合同专用条款”与“采购内容及要求”规定的附加服务：

- (1) 实施所供服务的系统集成和试运行；
- (2) 提供货物组装和维修所需的工具；
- (3) 为所供本项目提供详细的操作和维护手册；

(4) 在双方商定的一定期限内对本项目实施运行维护和修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同质量保证期内所承担的义务；

7.2 卖方提供的上述伴随服务均应含在合同总价中，买方不再为其单独一项或数项另外支付费用。

7.3 卖方应提供“合同专用条款”和“用户需求书（采购内容及要求）”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8. 保证

8.1 在质量保证期内所发现的缺陷，买方应尽快以书面方式通知卖方。

8.2 如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规



定对卖方行使的其他权力不受影响。

8.3 卖方对故障或缺陷的处理结果应使买方满意。

8.4 交货期：甲乙双方合同签订后，乙方收到甲方书面供货通知函后的 30 个工作日内完成所有的供货。

9. 索赔

9.1 如果卖方对偏差负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

(1) 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回产品所需的其他必要费用。

(2) 根据产品的偏差情况、损坏程度，以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低产品的价格。

(3) 用符合合同规定的品牌、规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一节费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

9.2 如果在买方发出索赔通知后十五（15）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后十五（15）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款中扣回索赔金额。

10. 付款

本合同项下的付款方法和条件在“合同专用条款”中有规定。

11. 价格

卖方在本合同项下提交产品和履行服务的价格在合同中给出。

12. 变更指令

12.1 买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

(1) 本合同项下提供的产品是为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

(2) 运输或包装的方法；



(3) 交货地点；

(4) 卖方提供的服务。

12.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后十五（15）天内提出。

13. 合同修改

除了合同条款第 12 条的情况，不对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

14. 转让

未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

15. 分包

对招标文件中没有明确分包的内容，卖方在未取得买方书面同意的通知，不得擅自进行分包，但分包通知并不能解除卖方履行本合同的任何责任和义务。

16. 卖方履约延误

17.1 卖方应按照招标文件中规定的时间交货和提供服务。

17.2 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

17.3 除了合同条款第 19 条的情况外，卖方完工延误，将按合同条款第 19 条的规定被收取误期赔偿费。

17. 误期赔偿费

除合同条款第 19 条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的工期完工，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟完工工程部分或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至完工或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第 20 条的规定终止合同。



18. 违约终止合同

18.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款规定同总延长的期限内完成部分或全部工程。

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

(3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件。

(a) “腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

(b) “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

18.2 如果买方终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

19. 不可抗力

19.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

19.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续六十天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

20. 因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将



要采取的任何行动或补救措施的权利。

21. 因买方的便利而终止合同

21.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

21.2 对卖方收到终止通知后十五（15）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

（1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受。

（2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

22. 争议的解决

22.1 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商开始后三十（30）天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。仲裁地点为安康仲裁委员会。

22.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

22.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

22.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

23. 合同语言

本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函均用中文书写。

24. 适用法律

本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25. 通知

25.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式传真送到“合同专用条款”中规定的对方的地址。传真需经书面确认。

25.2 通知以送达日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

26. 税款

26.1 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需缴纳的与本合同有关的一切税旨均应由买方负担。

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



26.2 按照中华人民共和国税法 and 有关部门的规定，卖方需缴纳的与本合同有关的一切税旨均应由卖方负担。

27. 合同生效及其他

27.1 本合同经买卖双方及招标单位授权代表签字盖章后生效。

27.2 如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。

27.3 本合同具有法律效力，受国家法律保护。

27.4 本合同一式伍份，买方（使用单位）贰份，卖方贰份，招标代理机构壹份。

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



二、合同格式

采购合同

甲方：白河县人民医院

统一社会信用代码：

地址：

联系方式：

法定代表人/负责人：

乙方：

统一社会信用代码：

地址：

联系方式：

法定代表人/负责人：

甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，就甲方向乙方采购的相关事宜签订本合同。

一、采购设备详况：

序号	设备名称	设备规格参数 (厂家、品牌、规格、型号、材质)	单位	数量	单价
1					
2					
3					
4					

二、合同价款：

1、合同总价款大写：_____（¥：_____）。

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



2、合同总价款包括但不限于本合同约定的所采购设备的设备费、运输费、装卸费、仓储费、保险费、安装调试费、售后服务费及税费等乙方完成本合同约定的全部合同义务所产生的所有费用在内。

三、付款方式：

合同签订后一个月内支付合同总金额的 40%；设备安装调试培训验收合格后半年内支付合同总金额的 50%；剩余的 10%使用满一年后一次性支付。

四、验收：

1、本合同约定的设备到达甲方指定地点后，乙方应通知甲方进行初验，即甲方根据本合同要求，对乙方交付的设备进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。若甲方在验收时发现乙方提供的设备与合同约定不相符时，乙方应自甲方通知之日起___日内重新按照合同约定补足或更换设备，乙方每逾期一日，乙方应向甲方支付___元的违约金。若乙方逾期达到___天，甲方有权选择解除合同，并由乙方赔偿甲方的全部损失。

2、设备安装、调试正常，乙方自检合格之日起___日内通知甲方，由甲方组织相关人员进行最终验收，最终验收合格的标准为：_____，验收合格后，甲方填写《采购验收结算单》，一式二份，甲、乙双方各执一份，作为对货物的最终认可。若甲方验收不合格，乙方应自验收不合格之日起___日内重新调试并通知甲方验收，乙方每逾期一日，乙方应向甲方支付___元的违约金，若乙方逾期达到___天或乙方再次验收不合格，甲方有权选择解除合同，并由乙方赔偿甲方的全部损失，包括但不限于甲方已经支付的相应款项及因此所产生的相关赔偿款、甲方实现相关权利所产生的全部费用，如律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等。

3、无论何时甲方发现乙方提供的设备与甲方的要求及本合同的约定不相符的，甲方均有权要求乙方自甲方通知之日起___日内重新按照合同约定补足或更换设备，乙方每逾期一日，乙方应向甲方支付_____元的违约金。若乙方逾期达到_____天，甲方有权选择解除合同，并由乙方赔偿甲方的全部损失。

4、乙方必须在_____时向甲方提交本合同约定的设备的全部技术资料（包

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



括但不限于合格证、使用及维护说明书、出厂校准证书、装箱清单等），以便甲方日后管理和维护，若乙方不能按照本条款的约定提供全部技术资料，按乙方没有供货处理。

五、甲、乙双方的权利和义务：

1、甲方的权利和义务：

(1) 甲方在收到货物后，应按照本合同的约定进行核对，如发现产地、规格、型号和数量不符合合同约定，应及时提出；

(2) 甲方应按照合同的约定履行付款义务；

(3) _____ ；

(4) _____ 。

2、乙方的权利和义务：

(1) 乙方应保证按照本合同的约定向甲方供货。如果出现品种、数量、规格、质量不符合合同约定的，由乙方负责按照本合同的约定进行处理；

(2) 乙方必须按照本合同的约定履行合同义务，并确保本合同中的安装、维修工作及时到位。因为乙方的原因造成甲方的损失的由乙方承担；

(3) _____ ；

(4) _____ 。

六、交货地点：

1、交货地点：甲方指定的交货地点。

2、交货期：本合同约定的所有设备均需在____年__月__日前完成安装、调试并申请验收，且验收合格。

七、运输：

1、运输由乙方负责，费用已包含在合同总价内，包括所有的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

2、运输方式由乙方自行选择，但必须保证货物完好、按期交货到甲方指定地点。

八、质量保证：

1、乙方提供的设备设施必须是全新未使用、经国家质检部门检验合格并颁发了准销证的产品。

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



2、乙方确保产品整体技术性能达到现行国家标准、行业标准，美观实用，并符合本合同的约定。

九、售后服务：

1、乙方对所供设备实行____年免费保修，保修期自____之日起算，并提供终身维修服务（如因甲方人为原因引起设备损坏不在保修范围之内）。在质保期内出现质量问题，乙方接到甲方通知当日，应派专业人员到现场进行检测维修，产生的费用由乙方承担。若需送回生产厂家，往返费用由乙方承担，且乙方应确保修理期间甲方的相应工作不受影响，否则，乙方对甲方因此造成的全部损失进行赔偿。

2、在质保期内，排除故障不得超过____个工作日。否则，甲方有权指定第三方进行维护，由此产生的相应费用由乙方承担。

十、违约责任：

1、甲、乙双方均应按照合同的约定履行合同义务，否则，应按照本合同中的相关违约条款承担违约责任，本合同中未约定相关违约条款的，按《中华人民共和国民法典》的相关规定执行。

2、乙方交货期每超过一天，扣除乙方合同总价款的____%，迟延交货超过30天，甲方有权解除本合同并拒收货物。

3、乙方保证所有设备及其技术资料不会侵犯任何第三方的权利，如有发生，乙方在承担全部责任和对他第三方的赔偿外，以____倍的合同总价额赔偿给甲方，若该赔偿款不足以弥补甲方的全部损失的，乙方还应对不足部分进行赔偿。

十一、合同争议解决的方式：

本合同在履行过程中如发生争议，由甲、乙双方协商解决；经协商无法解决的可依法向甲方所在地人民法院起诉解决。

十二、合同生效：

本合同一式4份（甲方2份、乙方2份），经甲、乙双方法定代表人或负责人签字盖章后生效。

十三、其他事项：

1、合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商，变更增加补充合同，与原合同具有同等法律效力。

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



2、合同一经签订，不得擅自变更、终止。确需调整的，应按约定履行相应的手续。

甲 方（签章）：

乙 方（签章）：

法 定 代 表 人：

法 定 代 表 人：

委 托 代 理 人：

委 托 代 理 人：

签订日期： 年 月 日

签订日期： 年 月 日

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



第四部分 用户需求书（采购内容及要求）

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

一、采购清单

序号	名称	数量	单位	总预算（万元）
1	高档彩色多普勒超声诊断仪	1	台	300
2	高端彩色多普勒超声诊断仪	1	台	

二、技术参数

（一）高档彩色多普勒超声诊断仪技术规格及要求

一、设备用途及说明： <p>全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、高端体检及临床学术研究。具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。必须提供厂家发布的最新高端产品并且为最新版本。</p>
二、主要规格及系统概述
1. 主机系统性能概括：
1.1 ≥ 23 英寸高分辨率监视器，具备万向关节臂，可实现任意方位调节；
1.2 液晶触摸屏 ≥ 12 英寸，可与显示器同步显示实时图像，支持界面编辑及滑动翻页功能；
1.3 触摸屏支持数字 TGC 功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置；
1.4 操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转，支持全封闭式键盘；
1.5 原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节；
1.6 采用整场空间像素成像原理成像或域成像或相干成像；
1.7 智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比，可调节开关；
1.8 一体化耦合剂加热装置，温度可调；
1.9 具备数据防御系统；

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101




1.10 智能控制设备功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作；
1.11 影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示。
2. 二维灰阶成像单元：
2.1 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调；
2.2 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，支持 3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术；
2.3 空间复合成像：
2.3.1 支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数；
2.2.2 具有最大、平均、混合、运动校正四种复合模式，模式中具有三档开角可调节；
2.4 组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示；
2.5 组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头， ≥ 7 级可调，可显示具体数值；
2.6 高清放大功能：可对局部图像进行高清放大；
2.7 宽景成像：扫描长度 ≥ 90 cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，自动检测扫描方向，支持旋转及测量。
3. 先进成像技术：
3.1 血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度；
3.2 高级血流成像技术；
3.2.1 非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态；
3.2.2 无取样框、无角度依赖，无需注射造影剂的情况下观察血流动力学状态；
3.2.3 具有捕捉模式，把多帧图像累积到一起，按血流灌注先后顺序动态呈现



血管的空间分布状态；
3.2.4 可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流；也可支持组织+血流双幅显示或叠加显示的方式；
3.2.5 支持凸阵/高频凸阵、小微凸、线阵/高频线阵、面阵、相控阵及介入探头等；
3.3 超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号；
3.3.1 可支持腹部及小器官应用，支持 ≥ 4 支线阵探头；
3.3.2 具备多种彩色图谱，并具备方向性显示；
3.3.3 具备多级别背景模式选择， ≥ 7 级；
3.3.4 支持PW速度测量；
3.3.5 支持累积模式，累积级别可调控；
3.3.6 支持与B模式同屏对照显示，支持与实时拍摄的情景照片同屏对照显示；
3.3.7 支持立体显示模式；
3.3.8 超微细血流成像技术支持在造影模式下使用；
3.4 二维立体血流显示技术，立体程度可调节，可联合超低速血流技术和高穿透技术成像，并可支持测速；
3.5 穿刺针增强显示功能；
3.5.1 可独立调整穿刺针的显示增益；
3.5.2 多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径；
3.6 智能多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度。
4. 高级成像技术；
4.1 造影成像技术；
4.1.1 造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、面阵、腔内、容积探头等；
4.1.2 具有谐波造影，又有基波造影模式，并具备原厂高机械指数造影模式；
4.1.3 B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量；
4.1.4 支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器；

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



4.1.5 超声造影成像可与 CT\MR\PET-CT 等图像对照显示；
4.1.6 具备多种显示模式：单幅、双幅对照、平衡模式等；
4.1.7 具有全套机载一体化 TIC 时间强度分析及后处理功能，可在双幅对照图像上进行 TIC 时间强度曲线分析，感兴趣区 ≥ 8 个，可分析项目包括：均方误差、到达时间、曲线下面积、梯度、最大强度等；
4.1.8 具备参量成像功能使用不同颜色标记造影剂到达时间；
4.2 应变式弹性成像；
4.2.1 具备成像质量监控色棒和操作动作曲线；
4.2.2 可支持凸阵、线阵/超高频线阵、腔内、面阵等探头；
4.2.3 具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供 ≥ 8 个感兴趣区的硬度值和 ≥ 7 个感兴趣区与参照区的硬度比；
4.3 心脏成像功能：
4.3.1 标配成人心脏相控阵探头扫描角度 $\geq 120^\circ$ ；
4.3.2 二维支持像素优化技术，分级可调，智能抑制噪声，增强组织显示；
4.3.3 支持心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M 型和曲线解剖 M 型，支持斑点组织追踪成像功能；
4.3.4 心功能自动计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同屏分三部分图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到 EF、CO、SV 等心功能数据 ；
4.4 智能辅助功能：
4.4.1 具有胎儿生长指标和软指标的半自动测量功能，包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长；
★4.4.2 智能血管检查技术：一键自动完成整个血管检查；（包括自动识别血管位置、自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积及角度、自动优化图像、自动测量）；
★4.5 乳腺高效检查工具包：根据回声信号的识别，自动勾勒病灶的边界；
★4.6 甲状腺高效检查自动工具包：根据回声信号的识别，自动勾勒病灶的边界。
5. 测量和分析（B 型、M 型、频谱多普勒、彩色模式）：

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



5.1 一般测量；
5.2 妇产科测量：具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值；
5.3 心脏功能测量；
5.4 多普勒血流测量与分析；
5.5 外周血管测量与分析；
5.6 泌尿科测量与分析；
5.7 多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数自由选择；
5.8 图像存储与(电影)回放重现单元；
5.8.1 输入/输出信号：HDMI、USB 等；
5.8.2 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件(且可以作为中央服务器远程读取、调入、存储其他彩超图像)，支持压缩和高清 DICOM 图像传输；
5.8.3 超声图像存档与病案管理系统；
5.8.4 固态硬盘容量 \geq 1TB；
5.8.5 一体化剪贴板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统；
5.8.6 USB 一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至 U 盘、移动硬盘或者其它 USB 装置；
5.8.7 超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现；
5.8.8 动态图像、静态图像以 JPEG 或 WMV (MPEGVue) 格式直接存储于可移动媒介；
5.8.9 在屏剪贴板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析。
6. 技术参数要求：
6.1 系统通用功能；
6.1.1 监视器 \geq 23 英寸高分辨率监视器；
6.1.2 扫描方式：逐行扫描，高分辨率；全方位关节臂旋转；

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



6.1.3 系统动态范围 $\geq 390\text{dB}$;
6.1.4 探头接口 ≥ 4 个，可同时激活（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口；
6.2 探头规格：
6.2.1 频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调；
6.2.2 工作频率范围可在 1~16MHz 之间选择；
6.2.3 阵元：小器官面阵探头阵元数 ≥ 1000 阵元；
6.2.4 穿刺导向：探头可配穿刺导向装置，具备 ≥ 3 个穿刺角度；
6.3 二维灰阶显示主要参数：
6.3.1 探头性能：
6.3.1.1 腹部凸阵探头：超声频率 1.0~6.0MHz；
6.3.1.2 小器官线阵探头：超声频率 2.0~11.0MHz；
6.3.1.3 相控阵探头：超声频率 1.0~5.0MHz，扫描角度 $\geq 115^\circ$ ；
6.3.1.4 线阵探头，：超声频率 6.0~15.0MHz；
6.3.2 探头频率：
6.3.2.1 凸阵探头，18cm 深度，全视野，最高线密度下，二维帧频 ≥ 55 ；
6.3.2.2 凸阵探头，18cm 深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频 ≥ 15 ；
6.3.2.3 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85° ，最高线密度下，二维帧频 ≥ 70 ；
6.3.2.4 相控阵探头，18cm 深度，扫描角度 85° ，最高线密度下，彩色帧频 ≥ 30 ；
6.3.3 回放重现：灰阶图像回放 ≥ 3000 幅、回放时间 ≥ 30 秒；
6.3.4 预设条件针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，及常用所需的外部调节及组合调节；
6.3.5 增益调节：B/M 可独立调节，STC 分段 ≥ 8 ；
6.3.6 扫描深度 $\geq 45\text{cm}$ （提供附图）；
6.4 频谱多普勒；

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



6.4.1 方式：PW，CW，HPRF；
6.4.2 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示；
6.4.3 PWD：血流速度 $\geq 15\text{m/s}$ ；CWD：血流速度 $\geq 20\text{m/s}$ ；
6.4.4 最低测量速度： $\leq 0.6\text{mm/s}$ （非噪声信号）；
6.4.5 PW 取样容积范围：0.05cm \sim 2cm；
6.5 彩色多普勒；
6.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、方差显示；
6.5.2 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）；
6.5.3 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： $-20^{\circ} \sim +20^{\circ}$ ；
6.5.4 标配心脏探头彩色血流多普勒中心频率可视可调 ≥ 10 个（白皮书证明）；
6.5.5 高频线阵探头彩色血流多普勒中心频率可视可调 ≥ 8 个（白皮书证明）；
6.5.6 彩色多普勒能量图（PDI），彩色方向性能量图（DPDI）；
6.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler 输出功率可调；
7. 配置要求（单套配置）：
7.1 配套设施要求：
7.1.1 超声专用检查椅；
7.1.2 彩色打印机；
7.1.3 超声工作站主机： 显示器： ≥ 27 英寸，分辨率 $\geq 1080\text{p}$ ； 主机：内存 $\geq 8\text{G}$ 硬盘容量 $\geq 500\text{G}$ ； 处理器：13代 i5 水平以上； 显卡：独立显卡； 其他：机箱内配置配套专用图像采集卡； 键盘及鼠标；
7.1.4 护眼台灯、插排、办公桌；
7.1.5 彩超配套 ups（不间断电源），延时时长 ≥ 30 分钟；
7.2 负责与医院信息系统连接。



(二) 高端彩色多普勒超声诊断系统

一、设备用途及说明：


全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产、泌尿、浅表小器官与血管、儿科、肌骨神经、介入诊疗、高端体检及临床学术研究。具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。必须提供厂家发布的高端产品。

二、系统技术规格及概述：

1. 高分辨率彩色液晶显示器 ≥ 21 英寸；
2. 操作面板具备角度可调触摸屏 ≥ 12 英寸；
3. 控制面板可独立旋转、升降及平移；
4. 全聚焦相干成像，无焦点扫描成像技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致；
5. 组织特性匹配，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像；
6. 具备自动声速校正技术，系统可自动识别组织差异，可校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查；
7. 宽景成像技术，支持凸阵、线阵、相控阵探头，可自由进退和测量；
8. 空间复合成像，用于除相控阵外的所有探头，声束偏转线数 ≥ 9 条（曲别针试验显示9条扫描线并附图片）；
9. 斑点噪声抑制成像技术，可分级调节；
10. 梯形成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用，提供证明图片）；
11. 高分辨率血流成像，提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图象，更细微的显示末梢血流的动态情况，机器具备独立按键；
12. 智能化一键图像优化技术，具备独立按键；
13. 探头接口 ≥ 4 个（可同时激活）；
14. 图像全屏放大，具有特定按键，分级可调，支持2D、彩色、PW等模式；
15. 图像局部放大；
16. 支持立体血流成像技术，利用光照模型对二维灰阶血流进行渲染处理，支持所有探头；

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目


项目编号：DXZB-2025-0101



17. 智能肝肾灰阶值测量；
18. TDI 组织多普勒成像及定量分析；
19. 心脏射血自动测量功能；
20. 曲线解剖 M 功能；
21. 胎心组织追踪定量分析；
22. 穿刺针增强功能；
23. 标准化工作流程协议, 可根据不同操作者的使用习惯进行个性化自定义编程；
24. 斑点组织追踪成像功能。
三、测量/分析和报告
1. 常规测量，多普勒测量，自动频谱测量；
2. 全科测量包，自动生成报告腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科；
3. 胎儿生长指标自动测量功能：在获取合适切面的前提下，系统自动识别测量临床所需的胎儿双顶径，头围等多个参数；
4. 自动 NT 测量；
5. CPP 血流像素比；
6. 胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏≥15 个测量项目，并同时获得心脏发育评分。（提供证明图片）
7. 高级自动容积测量；
8. 颅内容积自动测量。
四、电影回放和原始数据处理
1. 所有模式下可用： 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5 分钟的电影支持图像对比（动态、静态）；
2. 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行 36 项参数调节。
五、系统技术参数及要求
1. 二维灰阶模式：

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



1.1 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件；
1.2 最大显示深度： $\geq 36\text{cm}$ ；
1.3 最大帧率： ≥ 650 帧/秒；
1.4 TGC： ≥ 8 段；
1.5 LGC： ≥ 6 段；
1.6 二维灰阶： ≥ 256 ；
1.7 动态范围： ≥ 160 ；
1.8 增益调节：B/M/D 分别独立可调， ≥ 100 ；
1.9 伪彩图谱： ≥ 8 种；
2. 彩色多普勒成像：
2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；
2.2 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW；
2.3 取样框偏转： $\geq \pm 30$ 度（线阵探头）；
2.4 最大帧率： ≥ 200 帧/秒；
2.5 支持 B/C 同宽；
3. 频谱多普勒模式：
3.1 包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒；
3.2 显示方式：B, PW, B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW 等等；
3.3 显示控制：反转、零移位、B 刷新、D 扩展、B/D 扩展等；
3.4 最大速度： $\geq 7.60\text{m/s}$ （连续多普勒速度： $\geq 30\text{m/s}$ ）；
3.5 最小速度： $\leq 1 \text{ mm /s}$ （非噪声信号）；
3.6 取样容积：0.5-30mm，支持所有探头；
3.7 偏转角度： $\geq \pm 30$ 度（线阵探头）；
3.8 零位移动： ≥ 8 级；
3.9 快速角度校正；
3.10 支持频谱自动测量。
4. 实时四维模式：支持多种模式渲染成像及裁剪等功能，容积图像支持斑点噪声抑制；

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目


项目编号：DXZB-2025-0101



4.1 支持深度渲染成像,通过深度伪彩的强弱显示不同距离间三维信息;
4.2 4D 最大显示帧率 ≥ 45 , 支持 VOI 在同一平面进行 360 度旋转;
4.3 智能断层成像技术,可将 3D 立体数据沿 A、B、C 三个正交平面分别进行连续平行断层切割,并可实时扫查,同屏显示数幅不同深度图像;
4.4 任意剖面成像技术,可直线、描述、线条等切割方法;
4.5 支持 3D 血流(血管三维成像,要求彩色及能量模式均可用);
5. 可变光源系统:通过改变光源位置得到常规容积成像的多方位容积增强显示;
★6. 胎儿头颅自动切面识别功能,自动获取胎儿颅脑四个标准切面,并自动获取 ≥ 6 项评估参数值;
★7. 胎儿面部自动容积成像,可一键自动去除胎儿面部前方遮挡物;
8. 盆底测量分析;
8.1 2D 盆底成像模式下,可一键自动测量膀胱颈距离值、膀胱后角值、膀胱距离值、尿道倾斜角值;
★8.2 3D 盆底成像模式下,可一键实现切面自动获取,部分切面识别及数据自动测量。(提供证明图片)
★9. 子宫内膜自动成像与容积分析功能,实现子宫内膜冠状面的自动获取;同时根据内膜轮廓还实现了内膜容积、厚度等参数的自动计算;
10. 具有小儿髋关节自动测量功能,可自动计算及进行临床分型;
11. 自动 workflow 协议,提供多个全身扫描协议。
六、造影及在机的造影定量分析功能
1. 双计时器,具备独立按键单独调节;
2. 动态存储时间 ≥ 8 分钟电影,支持向前存储;
3. 支持造影爆破;
4. 支持斑点噪声抑制技术,具有专门按键,逐级可调;
5. 具备二维和造影的叠加模式,可与二维图像同屏实时显示;
6. 支持造影叠加功能;
7. 支持造影和二维同步测量;
8. 支持专用病灶标记功能;

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



9. 支持多种造影剂，可针对造影剂选择对应参数设置；

10. 支持在机的造影定量分析；

11. 凸阵探头 10cm 深度，扫描角度 45°，帧率≥30 帧/秒；

12. 线阵探头 4cm 深度，帧率≥50 帧/秒。

七、实时组织弹性成像功能

1. 弹性成像图谱≥5 种可选；

2. 弹性模式具有压力操作提示图标；

3. 具备应变比值定量分析，可进行任意两个区域间的应变比计算；

4. 具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具；

5. 具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能。

八、剪切波定量式弹性成像功能

1. 包括二维实时剪切波和单点式剪切波成像，可以动态显示二维剪切波弹性成像图；

2. 具备≥3 种以上弹性质控方式；

3. 同时输出以 kPa 和 m/s 为单位的组织硬度定量数据；

4. 具备三种定量参数，（剪切波速度，杨氏模量和剪切模量）。

九、探头规格

1. 频率：超宽频带或变频探头；

2. 二维、彩色、多普勒均可独立变频；

3. 探头配置：凸阵、线阵、相控阵、腔内容积；

4. 探头频率：

4.1 所有探头均为宽频变频探头，二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3 段

4.2 阵元：最大有效阵元数≥570 阵元；

4.3 凸阵探头，带宽：1.8-6.0MHz，角度≥70°；

4.4 相控阵探头，带宽：1.5-4.5MHz；

4.5 线阵，带宽：3.8-13.0 MHz；

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



4.6 腔内容积探头：带宽 2.0-9.0MHz；

5. 穿刺引导：

凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能。

十、外设和附件

1. 主机具备耦合剂加热装置：360 度环绕加热方式，加热温度分级可控；

2. 专业腔内探头放置架。

十一、配套设施：

1. 超声专用检查椅；

2. 彩色打印机；

3. 超声工作站主机：

显示器：≥27 英寸，分辨率≥1080p；

主机：内存≥8G； 硬盘容量≥500G ；

处理器：13 代 i5 水平以上；

显卡：独立显卡 ；

其他：机箱内配置配套专用图像采集卡；

键盘及鼠标；

4. 护眼台灯、插排、办公桌 ；

5. 彩超配套 ups（不间断电源），延时时长≥30 分钟；

6. 负责与医院信息系统连接。

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



第五部分 评标办法



1. 评标委员会

1.1 招标机构将按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及有关规定组建评标委员会。

1.2 评标委员会由招标人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标方提交书面评标报告。

1.4 评标方法：**综合评分法**。

1.5 投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为投标文件的组成部分。

2. 投标文件的初审（资格审查及符合性检查）

2.1 根据《中华人民共和国政府采购法》第二十三条、《中华人民共和国财政部令第87号》第四十四条，由采购人或采购人委托的采购代理机构对供应商的资格进行审查。评标委员会将审查投标文件是否完整。

2.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

2.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标方可以接受，但这种接受将影响投标人的综合得分。

2.4 在详细评标之前，评标委员会要审查投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和技术参数相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

2.5 评标委员会不接受有选择的报价。

2.6 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。

3. 投标文件的详细评审

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



- 3.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细评审。
- 3.2 详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“技术”“价格”“商务”及“服务”等方面进行评审并按照百分制进行综合打分。

4. 落实政府采购政策

4.1 中小企业政府采购政策

4.1.1 本项目执行财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号，对符合政府采购关于中小企业扶持政策的小微企业投标人的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.1.2 本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立、依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。划分标准见工业和信息化部 统计局 发展改革委 财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

4.1.3 投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受前款办法规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.4 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

4.1.5 投标人需根据财政部 工业和信息化部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和工业和信息化部 统计局 发展改革委 财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）对照自身情况及所提供产品的制造商、服务商的信息自行判断是否全部属于中小微企业。出具《中小企业声明函》（见投标文件格式）的小微企业，享受小微企业扶持，否则不享受相关中小企业扶持政策。投标人提供的《中小企业声明函》在公示中标结果时公开。

4.1.6 投标人应对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

4.2 监狱企业政策

4.2.1 符合财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的监狱和戒毒企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱、戒毒企业的证明的，视同小型、微型企业享受10%的价格扣除，监狱、戒毒企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格优惠政策。

4.2.2 投标人为监狱企业且所投货物全部由监狱企业制造的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，未提供或出具证明文件的单位不符合要求的，不视为小型微型企业。

4.3 残疾人福利性单位政策

4.3.1 符合财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）并提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的投标人，视同小型、微型企业享受10%的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受价格优惠政策。

4.3.2 投标人为残疾人福利性单位且所投货物全部由残疾人福利性单位制造的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未提供的不视为小型、微型企业。



4.4 节能环境标志产品政策

4.4.1 执行财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、财政部 发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购品目清单〉的通知》（财库〔2019〕19号）、《财政部 生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）等政府采购政策，对获得符合政府采购政策的产品实施政府优先采购或强制采购。

4.4.2 投标人可以提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。采购代理机构通过中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）对获证产品信息进行核对。

4.4.3 投标人所投产品属于下列情形之一的，本应属于优先采购的，不再享受优先采购政策；属于强制采购的，则按无效投标文件处理：

- （1）未提供认证证书扫描件或经核对认证证书存在信息有误的；
- （2）认证证书已过期。

4.4.4 享受中小企业政府采购扶持政策的投标人，可以同时享受节能产品、环境标志产品优先采购政策。

4.4.5 鼓励中标（成交）供应商在提供**货物（产品）**包装、运输按照 财政部办公厅 生态环境部办公厅 国家邮政局办公室《关于印发〈商品包装政府采购需求标准〉（试行）、〈快递包装政府采购需求标准〉（试行）的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的环保要求进行包装。

5. 对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整。若该项目是专门面向中小企业采购的，则不享受价格扣除。

5.1 符合（财库〔2020〕46号）、（财库〔2022〕19号）文件规定的小微企业单位的评标价计算规则：

5.1.1 对符合规定的小型 and 微型企业（非联合体投标）报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

5.1.2 对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-4%）

5.1.3 确认为小微企业（含小型、微型企业，下同）投标的，应当同时符合以下条件：

5.1.3.1 符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）；

5.1.3.2 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.3.3 投标时须提供《中小企业声明函》；

5.2 符合（财库〔2017〕141 号）文件规定的残疾人福利性单位的评标价计算规则：

5.2.1 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

5.2.2 对于联合协议或者分包意向协议约定残疾人福利性单位的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-4%）

5.2.3 确认为残疾人福利性单位投标的，应当同时符合以下条件：

5.2.3.1 符合（财库〔2017〕141 号）文件相关规定。

5.2.3.2 投标时提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

5.2.3.3 投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3 符合（财库〔2014〕68 号）文件规定的监狱企业的评标价计算规则：

5.3.1 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-10%）

5.3.2 对于联合协议或者分包意向协议约定监狱企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-4%）

5.3.3 确认为监狱企业投标的，应当同时符合以下条件：

5.3.3.1 符合（财库〔2014〕68号）文件相关规定。

5.3.3.2 投标时提供本单位生产的货物，或者提供其他监狱企业生产的货物。

5.3.3.3 投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4 符合（财库〔2021〕19号）文件规定的来自贫困地区提供农副产品的评标价计算规则：

5.4.1 在政府采购活动中，对于来自贫困地区提供农副产品的投标人，报价给予 5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

其评标价=投标报价*（1-5%）

5.4.2 确认为来自贫困地区提供农副产品的投标人，应当同时符合以下条件：

5.4.2.1 符合（财库〔2021〕19号）文件相关规定，在 832 个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

5.4.2.2 投标时提供本单位生产的货物，或者提供其他贫困地区生产的货物。

5.4.2.3 投标人须提供相关证明文件。

5.5 符合节能产品文件规定的评标价计算规则：

5.5.1 投标货物涉及提供的所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”（相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



录》)的,其评标价=投标报价*(1-3%);(不是所有投标产品的不享受此项优惠)。

5.6 符合环境标志产品文件规定的评标价计算规则:

5.6.1 投标货物涉及提供的所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”(相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》)的,其评标价=投标报价*(1-3%);(不是所有投标产品的不享受此项优惠)。

6. 中标人的确定

6.1 评标委员会根据评标办法的规定对投标人进行评审排序,推荐综合得分最高的前三名为中标候选人,如果两个投标人得分相同时,取投标价格低者。形成评标报告,评审报告由评标委员会全体成员签字确认。

6.2 招标代理机构应在评标结束后2个工作日内,将评标报告送达采购人定标。

6.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内,根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序,确定排名第一的为中标人,也可以书面授权评标委员会评标后直接确定中标人,同时复函采购代理机构。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间提供书面说明,必要时提交相关证明材料;如果投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标因素	权值%	评价要素
价格	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值%×100 符合政策性优惠的,按照招标文件中第五部分,第5条执行。



<p>投标产品 技术指标 及功能评 审内容</p>	<p>30</p>	<p>依据各投标人响应的投标产品参数要求等情况进行评审：满足全部参数要求的计 30 分；标注“★”项为关键参数，每一项负偏离扣 3 分，其他每一项负偏离扣 1 分，扣完为止。 备注：提供佐证材料（包括但不限于产品技术说明书、国家认可的第三方检测报告、产品官方网站截图等相关证明材料），并标注页码。若不提供材料或提供虚假参数及材料应标的，按负偏离处理。</p>
<p>产品 选型</p>	<p>6</p>	<p>针对本项目所投设备选型合理、功能齐全，规格、型号，配套设施完整，技术资料齐全，并附有详细的配件清单，①配置齐全；②完全满足采购需求；③提供产品备品备件价目表，并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件表内价格收取费用。 每项满分 2 分，缺项不得分，每有一项内容存在缺陷，扣 0.5-1.5 分。</p>
<p>质量 保证</p>	<p>4</p>	<p>投标产品货源渠道正规（不限于授权书等）；符合国家的标准和有关规定，有完备可靠的质量保证措施；提供完整的资料证明文件（如产品彩页、技术白皮书、国家认可的第三方检验报告、产品技术说明书等），得 4 分。 有质量保证措施，经过有关部门检测。能保证使用单位正常使用和维护。提供部分资料证明文件，得 2 分。 能保证使用单位正常使用和维护。提供部分资料证明文件，得 1 分。 未提供相关资料证明文件得 0 分。</p>
<p>履约 能力</p>	<p>4</p>	<p>拟投入本项目的技术人员配备，内容包括：①人员配备；②职责分工；③相关人员资质证书；④提供相关人员近半年本单位社保缴纳证明等。 人员配备全面合理，责任制度明确符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施。</p>



		<p>每项满分 1 分，缺项不得分，每项内容存在缺陷，扣 0.5 分。</p>
供货方案	10	<p>提供详细具体的供货方案，内容包括：①备货、供货进度；②产品安装调试；③验收组织；④工作保障措施；⑤包装运输等。</p> <p>方案各项内容全面详细、阐述条理清晰详尽、符合本项目采购需求，能有效保障本项目实施。</p> <p>每项满分 2 分，缺项不得分，每项内容存在缺陷，扣 0.5-1.5 分。</p>
应急方案	4	<p>提供针对本项目的应急方案，内容包括①预防机制；②突发事件；③应急响应；④后期处置等。</p> <p>方案各项内容全面详细、阐述条理清晰、针对性强，实施性科学合理。</p> <p>每项满分 1 分，缺项不得分，每有一项内容存在缺陷，扣 0.5 分。</p>
售后及培训方案	10	<p>售后服务方案（6分）</p> <p>内容包括：①售后服务体系；②人员配置；③服务内容；④项目交付采购人后出现故障的响应时间、解决故障时间；⑤补救措施；⑥质保期及保修期巡检、质控、预防性维修方案等。</p> <p>售后服务方案各项内容全面详细、阐述条理清晰、针对性、可实施性强，能够向采购人提供专业的售后服务。</p> <p>每项满分 1 分，缺项不得分，每有一项内容存在缺陷，扣 0.5 分。</p> <p>培训方案（4分）</p> <p>内容包括：①培训人数；②培训时间；③培训内容；④培训方式等。</p> <p>培训方案各项内容全面详细、阐述条理清晰、针对性、</p>

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



		可实施性强，能够向采购人提供专业的培训服务。 每项满分 1 分，缺项不得分，每有一项内容存在缺陷，扣 0.5 分。
业绩	2	提供所投产品 2022 年 1 月 1 日至今项目业绩，投标文件中附有其业绩证明材料，业绩以完整合同复印件为依据，每提供一个计 1 分，满分 2 分。
备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的任意一种情形。		

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



第六部分 投标文件格式

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪 一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101

投 标 文 件

投 标 单 位：_____

采 购 代 理 机 构：_____

时 间：_____



目 录

- (一) 投标函（格式）；
- (二) 投标报价表（格式）；
- (三) 投标报价明细表；
- (四) 商务条款偏离表（格式）；
- (五) 技术规格偏离表（格式）；
- (六) 技术说明文件；
- (七) 法定代表人证明书或授权书（格式）；
- (八) 资格证明文件；
- (九) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
- (十) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明（格式）；
- (十一) 企业关联关系承诺书（格式）；
- (十二) 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）；
- (十三) 中小企业声明函（如有）（格式）；
- (十四) 残疾人福利性单位声明函（如有）（格式）；
- (十五) 监狱企业证明文件；
- (十六) “节能产品”“环境标志产品”证明材料（如有）；
- (十七) 投标方案；
- (十八) 优惠、培训、售后服务承诺（格式）；
- (十九) 项目业绩表（格式）；
- (二十) 其他证明材料。



一、投标函

投 标 函

致：陕西德信招标有限公司

我方确认收到贵方提供 (项目编号) (项目名称)招标文件的全部内容，我方： (投标人名称)作为投标者正式授权 (授权代表全名、职务)代表我方进行有关本投标的一切事宜。

提交电子投标文件（扩展名为“.SXSTF”），包括如下等内容：

- （一）投标报价表；
- （二）投标报价明细表；
- （三）商务条款偏离表；
- （四）技术规格偏离表；
- （五）技术说明文件；
- （六）法定代表人证明书或授权书；
- （七）资格证明文件；
- （八）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
- （九）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；
- （十）企业关联关系承诺书；
- （十一）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书；
- （十二）中小企业声明函（如有）；
- （十三）残疾人福利性单位声明函（如有）；
- （十四）监狱企业证明文件（如有）；
- （十五）“节能产品”“环境标志产品”证明材料（如有）；
- （十六）投标方案；
- （十七）优惠、培训、售后服务承诺；
- （十八）项目业绩表；
- （十九）其他证明材料。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点。

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



- (一) 我方决定参加：_____（项目编号）_____（项目名称）的投标。
- (二) 全部货物及有关服务的投标总价为：_____（大、小写）。
- (三) 本投标文件的有效期在投标截止日后____天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。
- (四) 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力。
- (五) 我方明白不得在规定的开标时间和日期之后、投标有效期之内撤回投标。
- (六) 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其他数据或信息。
- (七) 我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的投标。
- (八) 我方如果中标，将保证履行招标文件及其补充文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。
- (九) 如我方中标，我方将在收到中标通知书之前，参照国家计委（2002）1980号、发改委（2003）857号文件规定标准向陕西德信招标有限公司交纳中标服务费。
- (十) 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

投标人名称（加盖公章）：_____

联系地址：_____

投标人授权代表职务：_____

投标人授权代表签字：_____

联系电话：_____

电子邮件：_____

传 真：_____

日 期：_____

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



二、投标报价表

项目名称： _____

项目编号： _____

序号	货物名称	品牌	型号和规格	数量	单价（元）	投标总价（元）	制造商名称	交货期	质保期	备注
合计	(大写)： _____ (小写)： _____									

投标人（盖章）： _____

法定代表人签字或签章： _____

日期： _____年____月____日

注：投标报价应包括货物费用、随机备品备件、验收、运输费用（货物到最终用户的运费）、安装调试费用、人员培训及投标等全部费用。

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



三、投标报价明细表

(自行编制格式)

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



四、商务条款偏离表

（说明）供应商应根据其提供的服务，对照招标文件合同专用条款要求逐条响应，商务条款不可负偏离，否则视为无效投标。

项目名称：_____ 项目编号：_____

序号	招标文件要求	投标文件内容	偏离	备注

注：请对招标文件商务要求内容逐条响应。

投标人（公章）：_____

授权代表（签名或盖章）：_____

日期：_____

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



五、技术规格偏离表

（说明）技术偏离表不得完全复制粘贴招标文件技术参数要求，否则视为无效
投标。技术偏离表响应内容须提供相关技术支持资料。

项目名称：_____ 项目编号：_____

序号	招标文件要求	投标文件内容	偏离	备注

注：1. 请对招标文件采购内容及要求内容逐条响应。偏离情况写“正/负/无偏离”。

2. 行数不够，可自行添加。

投标人（公章）：_____

授权代表（签名或盖章）：_____

日期：_____

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



六、技术说明文件

(提供所投产品技术支持资料，内容格式自拟)

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



七、法定代表人证明书或授权书

(一) 法定代表人证明书格式（投标人为法定代表人时须出具）

致：陕西德信招标有限公司				
企业法人	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	网址			
	统一社会信用代码			
法定代表人	姓名		性别	
	职务		联系电话	
	传真			
法定代表人身份证复印件	二代身份证正、反两面都需复印 (粘贴处)		(法定代表人签字)	
			(企业公章) 年 月 日	

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



(二) 法定代表人授权书格式（投标人为授权代表时必须出具）

致：陕西德信招标有限公司

本授权书声明：注册于_____（国家或地区）的_____

（投标人名称）的在下面签字的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就陕西德信招标有限公司（项目名称、项目编号为_____）招标文件的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书____年__月__日至____年__月__日签字生效，特此声明。

投标人名称：（公章）

地址：

法定代表人：（签名或盖章）

职务：

被授权人：（签名或盖章）

职务：

法人代表与被授权人身份证（复印件）需附在投标文件中。



八、资格证明文件

1. 具有独立承担民事责任能力的法人或非法人组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照等证明文件；

2. 投标人为生产厂家的须提供医疗器械生产许可证（进口产品除外）；投标人为代理商的根据所投产品类别还需提供第二类医疗器械备案凭证或第三类医疗器械经营许可证；根据所投产品的类别出具该类产品注册证；

3. 提供经会计师事务所审计的 2023 年财务审计报告或投标截止日前半年内任意一个月的财务报表（至少应包含资产负债表、利润表和现金流量表）或银行出具的资信证明；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；

4. 提供投标截止日前半年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，成立不足一年的公司提供自成立后至今连续缴存社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；

5. 提供投标截止日前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明，单据应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章；依法免税的单位应提供相关证明材料；（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）；

6. 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准；

7. 本项目不接受联合体投标。

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



九、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

(格式自拟)

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



十、提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明

无重大违法记录声明

陕西德信招标有限公司：

我_____（投标人名称）以下简称“我公司”参加_____（项目编号）_____（项目名称）的投标，本公司郑重声明，我公司参加本项目招标活动前____年内____（如实填写有或无）重大违法记录，符合法律法规的有关规定，我公司对此声明负全部法律责任。

特此声明！

投标人名称：_____（公章）

_____年__月__日

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



十一、企业关联关系承诺书

供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

致：陕西德信招标有限公司

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：_____

与我方存在直接控股、管理关系的单位名称如下：_____

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

投标人名称：_____（公章）

_____年__月__日

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



十二、陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1. 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2. 不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3. 不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
4. 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5. 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
6. 不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
7. 不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8. 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9. 不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称：

公章：

授权代表签字：

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



十三、中小企业声明函（如有）

请各位投标商根据实际情况提供，没有则不提供。投标人声明函将随结果公告一同公布，接受社会监督。

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 填写前请认真阅读《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



十四、残疾人福利性单位声明函（如有）

根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



十五、监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

单位名称（盖章）：

日 期：

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



十六、“节能产品”“环境标志产品”证明材料（如有）

供应商提供的产品属于下列情形的，提供产品列入“节能产品”“环境标志产品”证明材料（如有）所在页的复印件（该页包含制造商或企业名称或申请单位名称、规格型号、有效期截止日期等内容），并加盖供应商单位公章。

1、符合政府采购强制采购政策的财政部、环境保护部发布的《节能产品政府采购清单》中标记的“强制采购节能产品”。

2、符合政府采购强制采购政策的财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中标记的“环境标志产品”。


注：本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



十七、投标方案

(根据评审因素，内容格式自拟)

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



十八、优惠、培训、售后服务承诺

18.1 优惠条件承诺书

致：陕西德信招标有限公司

经仔细阅读你们的招标文件，我们同意招标文件中有关优惠条件的要求，对所投标项目向贵单位特做如下优惠条件承诺：

(1) ...

(2) ...

(3) ...

...

特此承诺！

承诺方授权代表签字：_____

职 务：_____

承诺方名称：_____

承诺方印章：_____

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

日期： 年 月 日

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



18.2 培训计划承诺

(根据评审因素内容中：售后及培训方案中“培训方案”进行编制)

致：陕西德信招标有限公司

经仔细阅读你们的招标文件，我们同意招标文件中有关培训计划的要求，对所投标项目向贵单位特做如下培训计划承诺：

(1) ...

(2) ...

(3) ...

...

特此承诺！

承诺方授权代表签字：_____

职 务：_____

承诺方名称：_____

承诺方印章：_____

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

日期： 年 月 日

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



18.3 售后服务

(根据评审因素内容中：售后及培训方案中“售后服务方案”进行编制)

致：陕西德信招标有限公司

经仔细阅读你们的招标文件，我们同意招标文件中有关售后服务方案的要求，对所投标项目向贵单位特作如下售后服务方案：

(1) ...

(2) ...

(3) ...

...

特此承诺！

授权代表签字：_____

职 务：_____

承诺方名称：_____

承诺方印章：_____

地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

日期： 年 月 日

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



十九、项目业绩表

提供所投产品 2022 年 1 月 1 日至今项目业绩

序号	项目名称	项目地址及电话	合同内容	签订日期

注：须提供业绩相应的证明材料（以采购合同为依据）。

项目名称：白河县人民医院彩色多普勒超声诊断仪一批采购项目

项目编号：DXZB-2025-0101



二十、其他证明材料